

5 系列 MSO

混合訊號示波器產品規格表

擁有最大的螢幕。最多的通道。最卓越的體驗。



優異的規格

輸入通道

- 4 個、6 個或 8 個 FlexChannel[®] 輸入通道
- 各 FlexChannel 提供一個類比訊號輸入，或搭配 TLP058 邏輯探棒的八個數位邏輯輸入

頻寬

- 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz (可升級)

取樣率 (所有類比/數位通道)

- 即時：6.25 GS/s
- 內插：500 GS/s

記錄長度 (所有類比/數位通道)

- 62.5 M 點標準
- 125 M 點選配升級

波形擷取率

- >500,000 波形/s

垂直解析度

- 12 位元 ADC
- 在高解析度模式中高達 16 位元

標準觸發類型

- 邊緣、脈波寬度、矮波、逾時、視窗、邏輯、設定/保持、上升/下降時間、並列匯流排、序列

標準分析

- 游標：波形、垂直線條、水平線條、水平加垂直線條
- 量測：36
- FastFrame[™]：具有最大觸發率 >5,000,000 個波形/秒的分段記憶體擷取模式
- 繪圖：時間趨勢、分佈圖和頻譜
- 數學運算：基本波形數學運算、快速傅立葉轉換和進階方程式編輯器
- 搜尋：依任何觸發準則來搜尋
- 抖動：TIE 和相位雜訊

選配分析¹

1 可選配且可升級。

2 註冊產品即可免費獲得。

3 目前無法在已安裝選項 5-WIN、SUP5-WIN (Microsoft Windows 10) 的儀器中提供。

- 進階抖動和眼圖分析
- 進階功率分析

選配串列匯流排觸發、解碼和分析¹

- I²C、SPI、RS-232/422/485/UART、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、USB 2.0、乙太網路、I²S、LJ、RJ、TDM、MIL-STD-1553、ARINC 429

任意/函數產生器¹

- 50 MHz 波形產生
- 波形類型：任意、正弦波、方波、脈波、斜波、三角形、直流層、高斯、羅倫茲、指數上升/衰減波、Sin(x)/x、隨機雜訊、Haversine 波、Cardiac 波

數位電壓計²

- 4 位數交流 RMS、直流和直流+交流 RMS 電壓量測

觸發計頻器²

- 8 位數

顯示器

- 15.6 英寸 (396 公釐) 彩色 TFT
- 高解析度 (1,920 x 1,080)
- 電容性 (多點觸控) 觸控式螢幕

連接能力

- USB 主機 (7 埠)、USB 裝置 (1 埠)、LAN (10/100/1000 Base-T 乙太網路；相容於 LXI)、顯示埠、DVI-D、視訊輸出

e*Scope^{®3}

- 使用網路連接透過標準的網頁瀏覽器，從遠端檢視和控制示波器

標準探棒

- 每個通道有一支 10 MΩ 被動電壓探棒，電容性負載小於 4 pF

保固

- 具有選配的全方位保護方案的 3 年標準保固

尺寸

- 12.2 英吋 (309 公釐) H x 17.9 英吋 (454 公釐) W x 8.0 英吋 (204 公釐) D
- 重量：<25 磅(11.4 公斤)


搭配優異且創新的捏合/滑動/縮放觸控式螢幕使用者介面、業界最大的高解析度螢幕顯示器，以及 4、6 或 8 個可讓您在每個通道量測一個類比或八個數位訊號的 FlexChannel[®] 輸入通道，5 系列 MSO 已準備好迎接當下及未來最嚴峻的挑戰。它確立了效能、分析和整體使用者經驗的新標準。

千萬別因為通道不夠，又讓驗證和偵錯程序變慢！

5 系列 MSO 提供四個、六個和八個通道的型號，配備 15.6 英吋高解析度 (1,920 x 1,080) 大螢幕，讓您更清楚觀察複雜的系統。在許多應用上，例如嵌入式系統、三相電力電子裝置、汽車電子裝置和直流對直流電源轉換器，需要觀察超過四個的類比訊號，才能驗證和判斷裝置效能，並針對難解的系統問題進行偵錯。

大部分工程師在回想起對特別困難的問題進行偵錯時，會想要有更好的系統可視性和環境，但他們所使用的示波器都只有兩個或四個類比通道。使用第二個示波器需要費力調準觸發點、難以判斷兩個面板的時序關係，還有書面記錄方面的難題。

或許您以為六個和八個通道的示波器，成本會比四個通道的示波器高出 50% 或 100%，但您將會很驚喜地發現，六個通道的型號成本只比四個通道的型號高出 ~25%，而八個通道的型號成本也只比四個通道的型號高出 ~67%。額外的類比通道可讓您如期完成目前和未來的專案，很快就能回收成本。

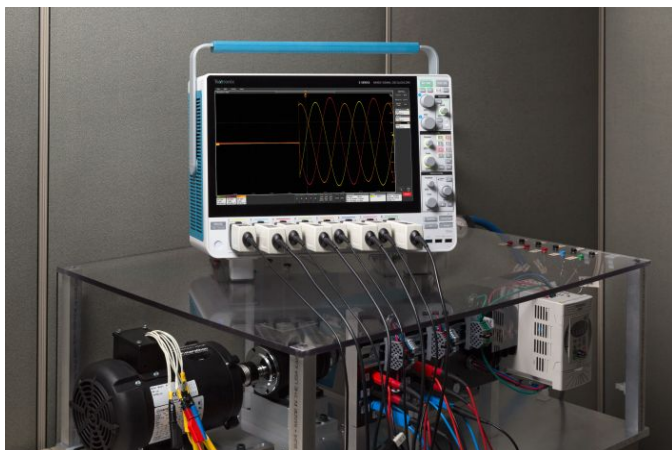

三相馬達啟動後會進行電壓量測，顯示三相輸入電壓。

FlexChannel[®] 技術可發揮最大彈性和更廣的系統可見性

5 系列 MSO 重新定義何謂混合訊號示波器 (MSO)。FlexChannel 技術可將儀器的每個輸入當成單一類比通道或八個數位通道。只要將 TLP058 邏輯探棒接到任何輸入，就完成轉換。想像一下這種彈性和組態。

您可以配置具有八個 FlexChannel 的型號來檢查八個類比訊號，而不檢查數位訊號。或者，七個類比和八個數位訊號。或者，6 個類比和 16 個數位訊號、5 個類比和 24 個數位訊號，依此類推。您可隨時新增或移除 TLP058 邏輯探棒來變更組態，以維持正確的數位通道數目。




FlexChannel 技術可發揮最大的彈性。根據您接上的探棒類型，每個輸入可配置成單一類比通道，或八個數位通道。

5 系列 MSO 將數位通道提升到更高的整合層次。在長時間擷取過程中，數位通道在精細時序解析度和很長的記錄上 (多達 125 M 點)，與類比通道具有相同的高取樣率 (高達 6.25 GS/s)。上一代 MSO 需要取舍，因為相較於類比通訊，數位通道的取樣率較低或記錄長度較短。



TLP058 提供八個高效能數位輸入。請依需要連接足夠的 TLP058 探棒，最多可形成 64 個數位通道。

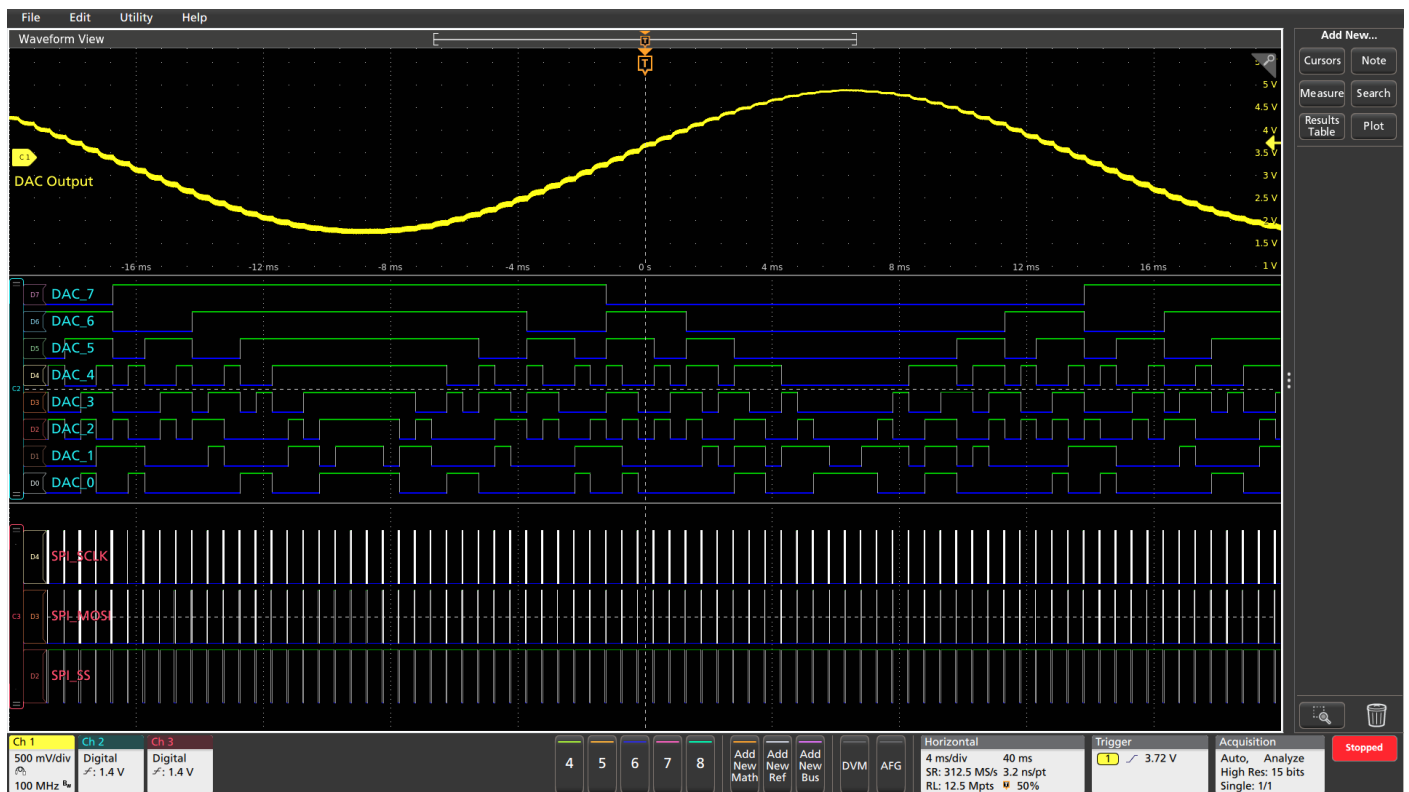


FlexChannel 2 有一支 TLP058 邏輯探棒連接至 DAC 的八個輸入。請注意綠色和藍色的色彩編碼，1 是綠色，0 是藍色。FlexChannel 3 的另一支 TLP058 邏輯探棒正在探測驅動 DAC 的 SPI 匯流排。白色邊緣表示下次擷取時若放大或改為更快的掃描速度，即可取得較高頻資訊。

即使面板上的軌跡很平坦，色彩編碼的數位軌跡也可讓您輕鬆判斷邏輯訊號是 1 或 0。1 會顯示綠色，0 會顯示藍色。獨特的多次轉換檢測硬體會指出，一個取樣間隔內何時發生多次轉換。軌跡上的白色線條表示若放大或以更快的取樣率擷取，即可取得更多的資訊。通常，放大会揭露先前隱藏的突波。與其他 MSO 在所有數位通道上共用一個或兩個臨界值不同，此型號讓您可以在每個數位通道上定義明確臨界值，以輕鬆觀察不同的邏輯系列。

前所未有的訊號檢視功能

5 系列 MSO 中驚人的 15.6 吋 (396 公釐) 顯示器是業界最大的顯示器，顯示區域比配備 10.4 吋 (264 公釐) 顯示器的示波器大一倍。這也是解析度最高的螢幕，達到 Full HD 解析度 (1,920 x 1,080)，可讓您一次看到許多訊號，有充裕的空間可顯示重要讀數和分析。

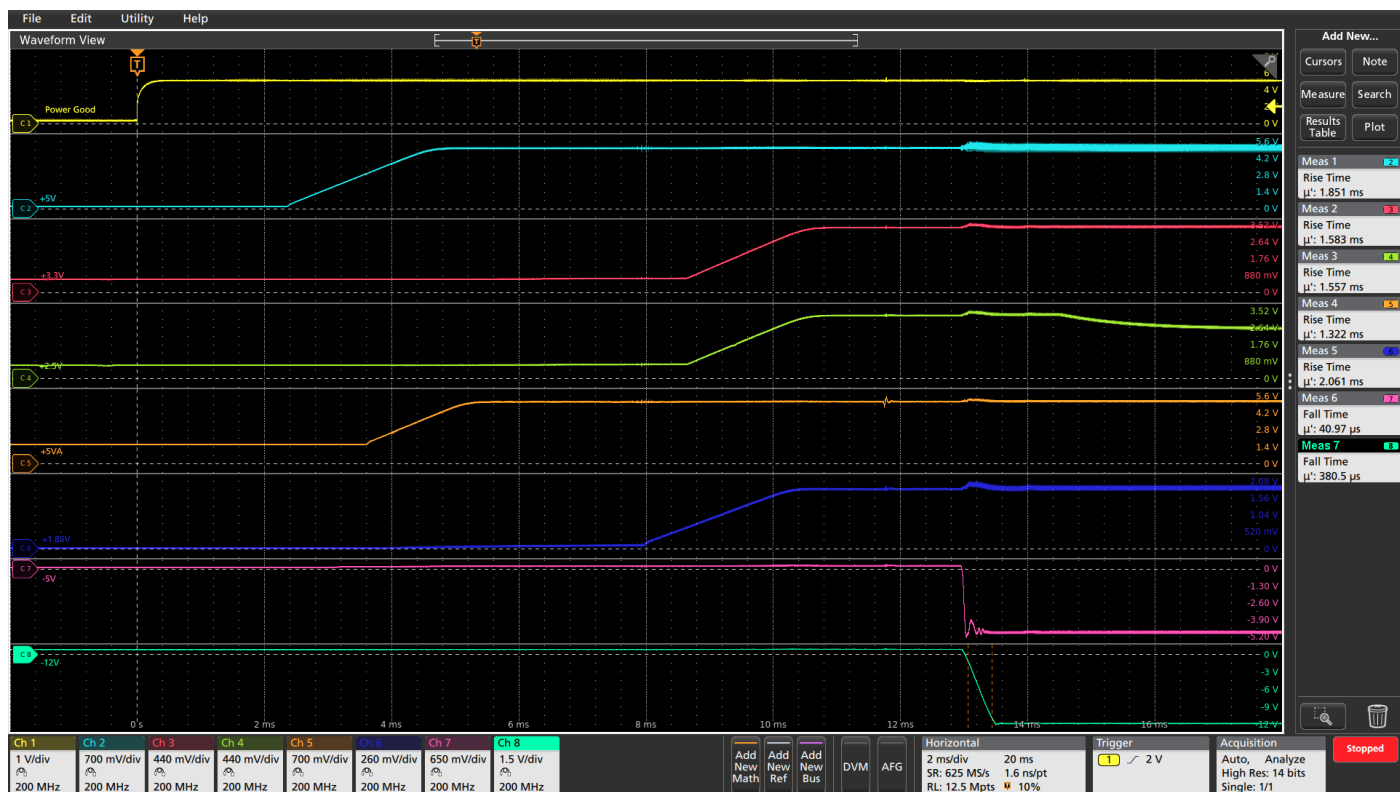

堆疊顯示模式可讓您輕鬆看到所有波形，同時在每個輸入維持最大的 ADC 解析度，以獲得最精確的量測。


5 系列 MSO 首創革命性的「堆疊」顯示模式。以往，示波器會在相同方格圖中重疊所有的波形，讓你不得不做出取舍：

- 為了看見每個波形，您必須垂直縮放並排列每個波形，以免重疊。每個波形都會佔用可用 ADC 的一小部分範圍，導致量測較不精確。
- 為了精確量測，您需要縮放並排列每個波形來填滿整個螢幕。波形彼此重疊，結果難以區別個別波形的訊號細節

檢視區域經過最佳設計，以確保有最大的垂直空間可顯示波形。右側的結果列可以隱藏，讓波形視檢視善用面板的全部寬度。

新的「堆疊」顯示不必再這樣犧牲。建立和移除波形時，就會自動新增和移除額外的水平波形「切片」(額外的方格圖)。每個切片都代表波形的完整 ADC 範圍。所有波形在外觀上彼此隔開，但仍使用完整的 ADC 範圍，達到最大的可視性和精確度。且這一切都隨著新增或移除波形而自動完成！

5 系列 MSO 的大型顯示器也提供足夠的檢視區域，不僅為了訊號，還能呈現繪圖、量測結果表、匯流排解碼表等等。您可以輕鬆地縮放和搬移各種視圖，以符合您的應用需求。

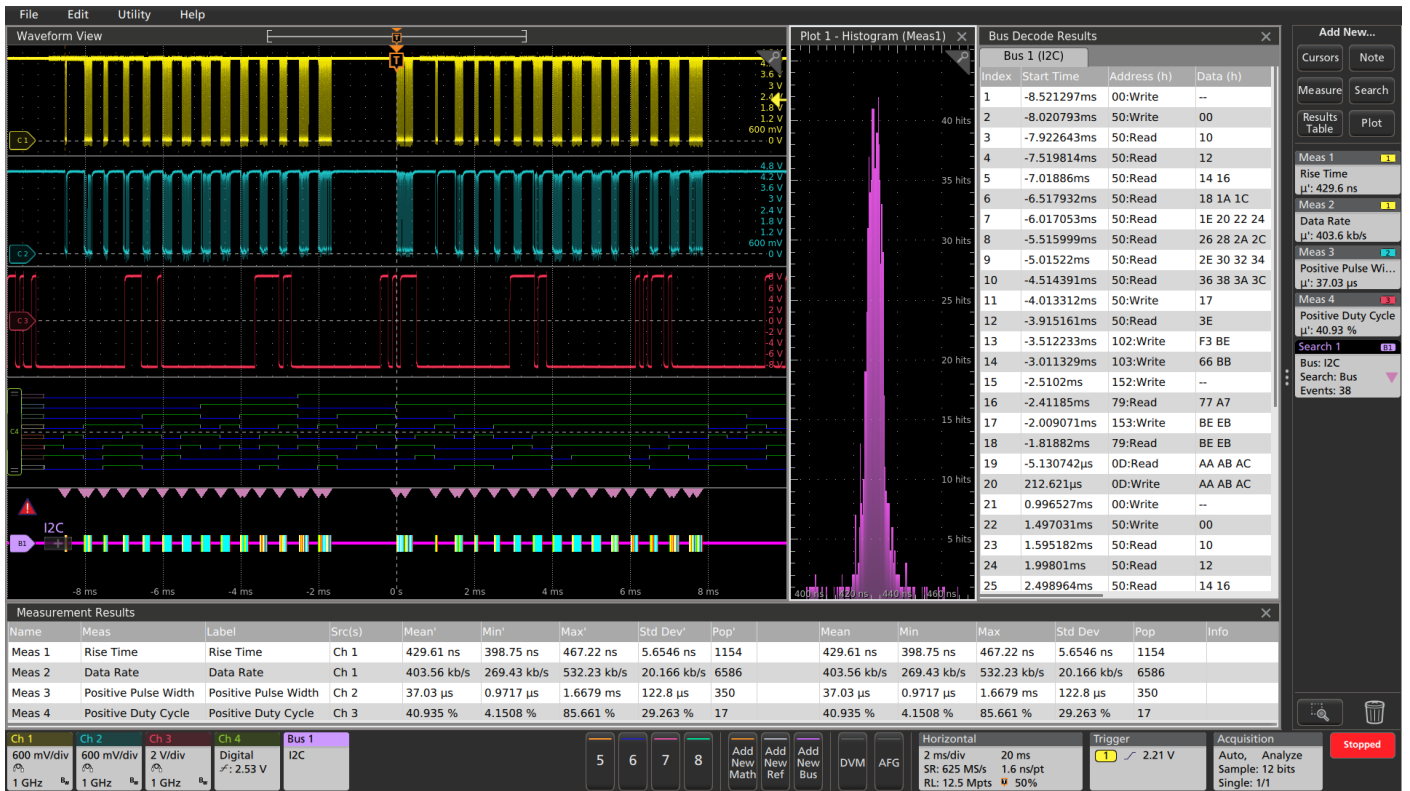

檢視三個類比通道、八個數位通道、一個解碼的序列匯流排波形、一個解碼的串列封包結果表、四個量測、一個量測分佈圖、含統計值的量測結果表，以及搜尋序列匯流排事件 - 全都同時進行！

極易使用的使用者介面讓您專心處理手邊的工作

設定列 - 重要參數和波形管理


沿著面板底部的設定列中，有一系列「標記」會顯示波形和示波器作業參數。設定列可讓您立即存取最常用的波形管理工作。只要點選一下就可以：

- 開啟通道
- 新增數學運算波形
- 新增參考波形
- 新增匯流排波形
- 啟用整合式任意/函數產生器 (AFG)
- 啟用整合式數位電壓計 (DVM)

結果列 - 分析和量測

面板右邊的結果列讓您點選一下，就能立即存取最常用的分析工具，例如游標、量測、搜尋、量測和匯流排解碼結果表、繪圖及註釋。

DVM、量測和搜尋結果標記都顯示在結果列中，完全不佔用波形檢視區域。若要有更大的波形檢視區域，您可以將結果列隱藏，然後隨時都可重現。

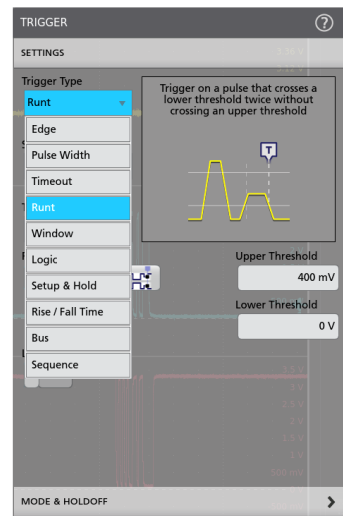

只要點兩下面板上感興趣的項目，即可存取組態功能表。本例中點兩下觸發標記來開啟「觸發」組態功能表。


徹底實現觸控互動

多年來，示波器已有觸控式螢幕，只不過觸控式螢幕一直都是另外添購。5 系列 MSO 的 15.6 英寸面板配備電容性觸控螢幕，是業界第一個真正觸控設計的示波器使用者介面。

您在手機和平板電腦上所使用，以及期待觸控裝置上應有的觸控互動表現，5 系列 MSO 都可支援。

- 將波形左/右或上/下拖曳可調整水平和垂直位置，或平移縮放視圖
- 捏合和張開，可依水平或垂直方向來變更刻度或縮放
- 將項目拖到垃圾桶即可刪除
- 手指從右側撥進來可顯示結果列，從上方撥下來可存取面板左上角的功能表

滑順、反應靈敏的前面板控制可讓您以熟悉的旋鈕和按鈕來調整，您還可以加進滑鼠或鍵盤當作第三種互動方法。

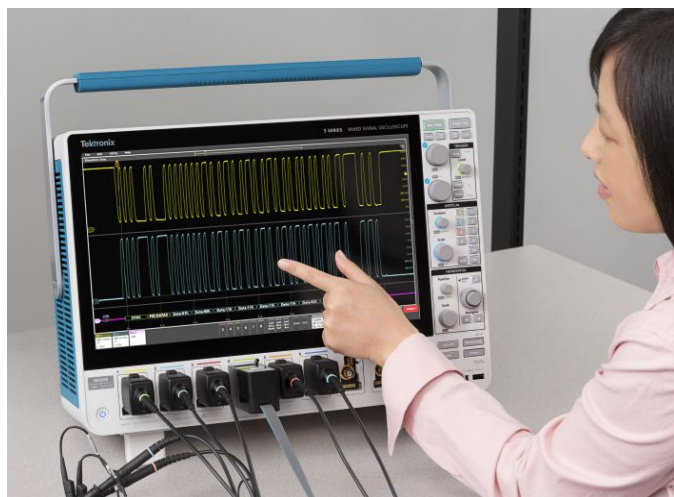

就像使用手機和平板電腦一樣，與電容性觸控螢幕互動。

前面板控制的具體細節

在傳統的示波器正面，面板和前面板各佔大約一半面積。5 系列 MSO 面板約佔儀器正面的 85%。為了達成此比例，經過簡化的前面板只保留重要的控制以求直覺化的操作，而減少了功能表按鈕，讓功能可直接透過面板上的物件來操作。

不同色彩的 LED 光環代表觸發源和垂直刻度/位置旋鈕指派。較大的專用「執行/停止」和「單次序列」按鈕特別放在右上方，其他功能全部都可以透過專用前面板按鈕來操作，例如強制觸發、觸發斜率、觸發模式、預設值設定、自動設定及快速儲存功能。



高效又直觀的前面板提供重要控制，但仍留有空間給 15.6 英寸的高解析度大螢幕。

是否需要 Windows - 由您選擇

5 系列 MSO 是第一款讓您選擇是否要內建 Microsoft Windows™ 作業系統的示波器。打開儀器底部的通路板就會看到固態硬碟 (SSD) 的連線。沒有 SSD 時，儀器開機後會成為專用的示波器，無法執行或安裝其他程式。

有 SSD 時，儀器會以開放式 Windows10 組態開機，可讓您將示波器應用程式最小化，並存取 Windows 桌面，然後您就可以在示波器上安裝並執行額外的應用程式。您也可以連接其他螢幕來延伸桌面。

不論是否執行 Windows，示波器運作起來完全相同，有相同的外觀和使用感覺及 UI 互動。

需要更高的通道密度嗎？

我們也提供具有低階外形尺寸的 5 系列 MSO - MSO58LP。5 系列 MSO 低階型具有八個 1GHz 輸入通道和輔助觸發輸入，高度為 2U 的套件且具有 12 位元的 ADC，於需要極高通道密度的應用領域，設定全新的效能標準。




體驗效能差異

5 系列 MSO 具備高達 2 GHz 的類比頻寬、6.25 GS/s 的取樣率、標準 62.5 M 記錄長度，以及 12 位元的類比至數位轉換器，效能足夠讓您擷取最佳訊號逼真度的波形，而解析度可讓您看見微小波形的細節。

數位螢光技術的 FastAcq™ 高速波形擷取

若要除錯設計問題，首先必須知道問題在哪裡。數位螢光技術搭配 FastAcq 可讓您快速深入瞭解裝置的實際作業。其快速波形擷取率 (大於每秒 500,000 個波形)，極可能讓您發現數位系統中常見的偶發問題：矮波脈波、突波、時序問題等等。為了進一步增強罕見事件的可視性，強度等級可表示相對於正常的訊號特性，罕見暫態訊號的發生頻率。

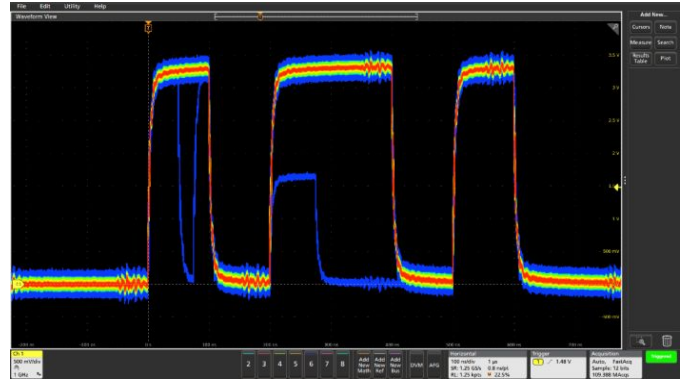


FastAcq 的高波形擷取率，可讓您發現數位設計中常見的偶發問題。

業界頂尖垂直解析度

當您需要擷取高振幅訊號，又想看到微小訊號的細節時，5 系列 MSO 的效能可讓您擷取特定訊號，並盡可能避免被討厭的雜訊所影響。5 系列 MSO 的核心是 12 位元類比至數位轉換器 (ADC)，提供的垂直解析度是傳統 8 位元 ADC 的 16 倍。

新的高解析度模式會根據所選取的取樣率，套用透過硬體設定的獨特有限脈衝響應 (FIR) 濾波器。FIR 濾波器會盡力為該取樣率保持最大頻寬，同時避免頻疊，針對所選取的取樣率，還會從示波器放大器和 ADC 移除高於可用頻寬的雜訊。高解析度模式一定會提供至少 12 位元的垂直解析度，在 ≤ 125 MS/s 取樣率之下，將會一路擴充至 16 位元的垂直解析度。

新的低雜訊前端放大器，更進一步改進了 5 系列 MSO 解析精細訊號細節的能力。

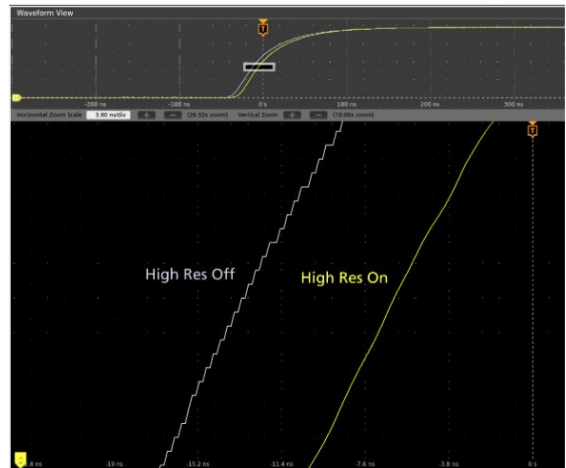


5 系列 MSO 的 12 位元 ADC，再結合新的高解析度模式，打造業界頂尖的垂直解析度。

觸發

發現裝置故障只是第一步。接下來，您必須擷取感興趣的事件以查明原因。5 系列 MSO 提供一組完整的進階觸發器，包括：

- 矮波
- 邏輯
- 脈波寬度
- 視窗
- 逾時
- 上升/下降時間
- 設定與違反時間保持
- 串列封包
- 並列資料
- 序列

有了長達 125 M 點的記錄長度，單次便能擷取許多感興趣的事件甚至數以千計的串列封包，但仍保有高解析度來放大精細訊號細節，並記錄可靠的量測。

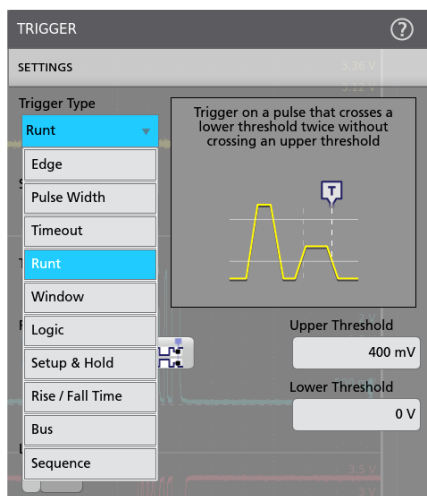

各種觸發類型和觸發功能表中的即時線上說明，可讓您比以往更輕鬆地隔離感興趣的事件。

準確的高速探測

每台 5 系列 MSO 隨附的 TPP 系列被動電壓探棒，都提供通用型探棒的所有優點 - 高動態範圍、彈性連線選項和強韌的機械設計，同時提供主動式探棒的效能。高達 1 GHz 的類比頻寬可讓您看見訊號中高頻率的分量，極低的 3.9 pF 電容性負載會將電路上的副作用降到最低，也更能接受較長的接地引線。

可選購的低衰減 (2X) 版 TPP 探棒可用於測量低電壓。不同於其他低衰減被動式探棒，TPP0502 具備高頻寬 (500 MHz) 與低電容性負載 (12.7 pF)。



5 系列 MSO 的每個通道都附有一支 TPP0500B (350 MHz、500 MHz 型號) 或 TPP1000 (1 GHz、2 GHz 型號) 探棒。

TekVPI 探棒介面

TekVPI[®] 探棒介面設定在探測時易於使用的標準。除了介面提供的安全、可靠連線外，許多 TekVPI 探棒還具備狀態指示器與控制項，以及補償盒上面就有的探棒功能表按鈕。此按鈕會在示波器畫面上顯示探棒功能表，以及探棒的所有相關設定與控制。TekVPI 介面可直接裝上目前的探棒，不需要另外的電源供應器。TekVPI 探棒可透過 USB 或 LAN 遠端控制，讓 ATE 環境中有更多元的解決方案。5 系列 MSO 提供高達 80 W 的電源給前面板接頭，足以啟動所有連接的 TekVPI 探棒，不需要額外的探棒電源供應器。

IsoVu™ 隔離量測系統

到目前為止，共模干擾會使工程師設計、偵錯、評估和最佳化時有「盲點」。設計換流器、最佳化電源供應、測試通訊連結、量測電流分流器阻抗的電壓、進行 EMI 或 ESD 問題偵錯，或是嘗試消除您測試設定裡的接地迴路，它是最佳工具。

Tektronix 革命性的 IsoVu 技術使用光學通訊和光纖傳電來達成完整的伽凡尼隔離。當結合配有 TekVPI 介面的 5 系列 MSO，它就是第一款 - 也是唯一一款 - 能夠準確解決高頻寬、差動訊號的量測系統，在大共模電壓下提供如下特性：

- 完整的伽凡尼隔離
- 最高 1 GHz 頻寬
- 100 MHz 下提供 100 萬比 1 (120 dB) 的共模互斥比
- 於全頻寬下提供 10,000 比 1 (80 dB) 的共模互斥比
- 最高 2,500 V 差動動態範圍
- 60 kV 共模電壓範圍



Tektronix TIVM 系列 IsoVu™ 量測系統提供伽凡尼隔離量測解決方案，
以在出現大共模電壓時，利用頻寬內同級最佳共模互斥效能，精確地解
析高頻寬、最高可達 2,500 V_{pk} 的差動訊號。

全方位分析可讓您快速洞察

基本波形分析


需要仔細分析，才能確保原型的效能符合模擬，且符合專案的設計目標，包括從簡單地檢查上升時間和脈波寬度開始，再擴及分析複雜的功率耗損、區別系統時脈的差異，以及調查雜訊源。

5 系列 MSO 提供一套綜合的標準分析工具，包括：

- 波形和螢幕為主的游標
- 36 種自動量測。量測結果包括記錄中的所有例證、能夠瀏覽各個事件，以及立即看到記錄中的最小值或最大值結果

- 基本波形數學
- 快速傅立葉轉換分析
- 進階波形運算，包括以濾波器和變數來任意編輯方程式
- FastFrame™ 分段記憶體可讓您以單次記錄擷取多個觸發事件，消除目標事件之間的大型時間差距，有效利用示波器的擷取記憶體。您能夠以個別或疊圖方式檢視並量測區段。

量測結果表提供量測結果的綜合統計檢視，涵蓋目前擷取和所有擷取的統計值。

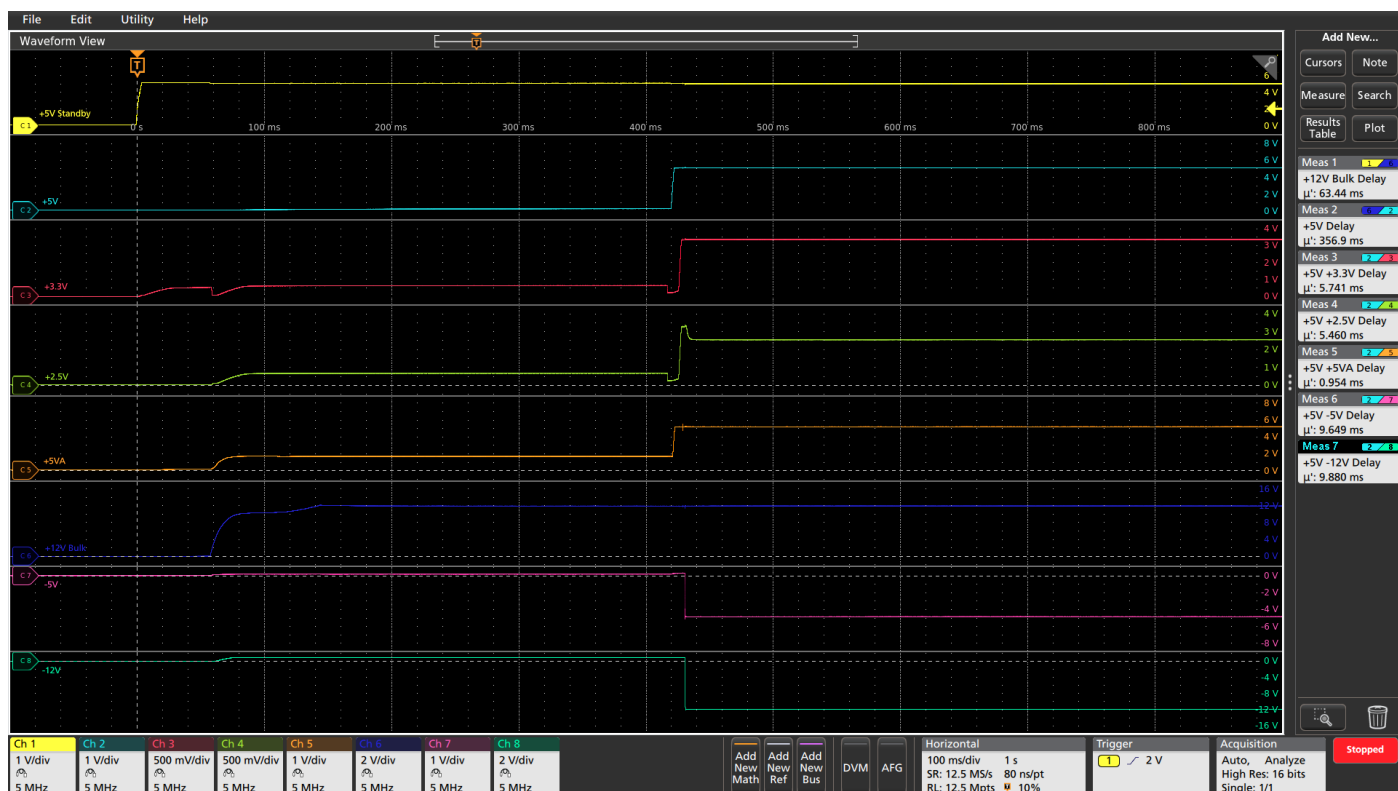

使用自動量測來描繪電源供應器啟動時的特徵。


瀏覽及搜尋

若無正確且合適的搜尋工具，要在長波形記錄中找出感興趣的事件將會耗費許多時間。現今的記錄長度動輒有數百萬個資料點，要找出事件，真的必須瀏覽數千個訊號活動畫面。

5 系列 MSO 以其創新的 Wave Inspector[®] 控制鈕提供業界最全方位的搜尋和波形瀏覽功能。這些控制項可加速您記錄的取景和縮放。有了獨特的飛梭 (force-feedback) 系統，只需幾秒即可從記錄的一端移到另一端。或者，直接在面板上利用直觀的拖曳和捏合/張開手勢，即可在冗長記錄中調查感興趣的區域。

「Search」(搜尋) 功能可讓您自動搜尋長時間擷取記錄中的使用者定義事件。所有發生的事件都會以搜尋標記反白，只要在前面板或面板上的搜尋徽章使用「Previous」(上一個，←) 與「Next」(下一個，→) 按鈕，即可輕鬆瀏覽所有事件。搜尋類型包括邊緣、脈波寬度、逾時、矮波、視窗、邏輯、設定和保持、上升/下降時間，以及並列/序列匯流排封包內容。您可以依喜好盡量定義夠多的獨特搜尋。

您也可以利用搜尋徽章上的「最小值」和「最大值」按鈕，快速跳到搜尋結果的最小值和最大值。

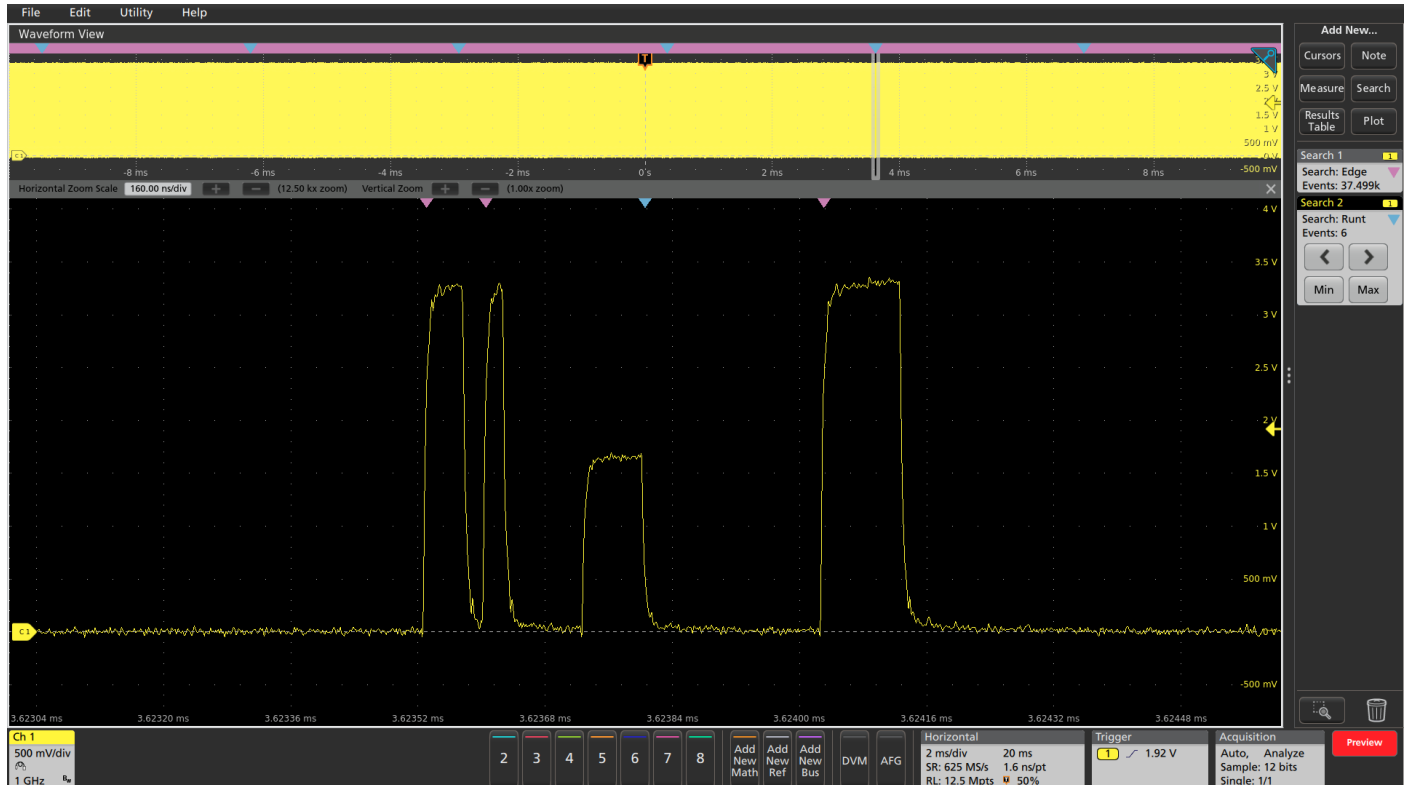

稍早，FastAcq 指出數位資料串流中出現矮波脈波，並建議進一步調查。在這段長達 20 ms 的擷取過程中，搜尋 1 指出擷取中有大約 37,500 個上升緣。搜尋 2 (同時執行) 指出擷取中有六個矮波脈波。

串列通訊協定觸發和分析 (選配)

在除錯期間，觀察一或多個序列匯流排的流量，以便追蹤通過系統的活動流程，可能會有寶貴的价值。手動將單一串列封包解碼就需要好幾分鐘，更遑論長時間的擷取過程中會有數以千計的封包。



在 USB 全速串列匯流排上觸發。匯流排波形會提供與時間相關的解碼封包內容，包括起始、同步、PID、位址、終點、CRC、資料值與停止，而匯流排解碼表會顯示整個擷取中的所有封包內容。

5 系列 MSO 提供一組強大的工具，可搭配嵌入式設計中最常見的串列匯流排使用，包括 I²C、SPI、RS-232/422/485/UART、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、USB LS/FS/HS、乙太網路 10/100、音訊 (I²S/LJ/RJ/TDM)、MIL-STD-1553 和 ARINC 429。

串列通訊協定搜尋可讓您在長串擷取的串列封包中搜尋，找出含有特定封包內容的串列封包。找到的事件都會以搜尋標記反白。若要快速切換標記，只需在前面板或結果列的搜尋標籤中，按下「Previous」(上一個，←)與「Next」(下一個，→)按鈕。

在許多設計中仍可看到並列匯流排。針對串列匯流排而說明的工具，也適用於並列匯流排。5 系列 MSO 的標準會支援並列匯流排。並列匯流排的寬度可達到 64 位元，也可能包含類比和數位通道的組合。

而且，假設您知道透過串列匯流排傳送特定指令時，就會發生您嘗試擷取的特定事件，那如果可以在該事件上觸發，不是更好嗎？可惜，這不像單純指定邊緣或脈波寬度觸發那麼輕鬆。


- 串列通訊協定觸發可讓您在特定封包內容上觸發，包括封包起始、特定位址、特定資料內容、唯一識別碼和錯誤。
- 匯流排波形會提供構成匯流排之個別訊號(時脈、資料、晶片啟用等)的高層級組合檢視，這讓識別封包開始點與結束點，以及識別子封包元件，例如位址、資料、識別碼、CRC 等，變得更為容易。
- 匯流排波形會與其他所有顯示的訊號按時間排列，可讓您在待測試中系統的各種元件之間，輕鬆量測時序關係。
- 匯流排解碼表會為擷取中的所有解碼封包提供表格視圖，與您在軟體清單看到的很像。封包會以時間戳記標記，並以直欄並排的方式列出每個元件(位址、資料等)。

抖動分析

5 系列 MSO 已無接縫整合 DPOJET Essentials 抖動與眼圖分析軟體套件，它可擴充示波器的功能，以單擊即時擷取對連續時脈和資料週期進行量測。如此一來即可量測主要的抖動和時序分析參數(如時間間隔誤差、相位雜訊)，對潛在的系統時序問題進行特性分析。

時間趨勢圖和分佈圖繪製等分析工具可迅速顯示時序參數於特定時間內的變化，頻譜分析則可迅速顯示抖動和調變來源的確切頻率 and 振幅。

選項 5-DJA 可增加額外的抖動分析功能，更能描繪裝置效能的特徵。31 個額外的量測提供完善的抖動與眼圖分析及抖動分解演算法，可讓您在現今的高速串列、數位和通訊系統設計中，找出訊號完整性問題及其相關訊號源。

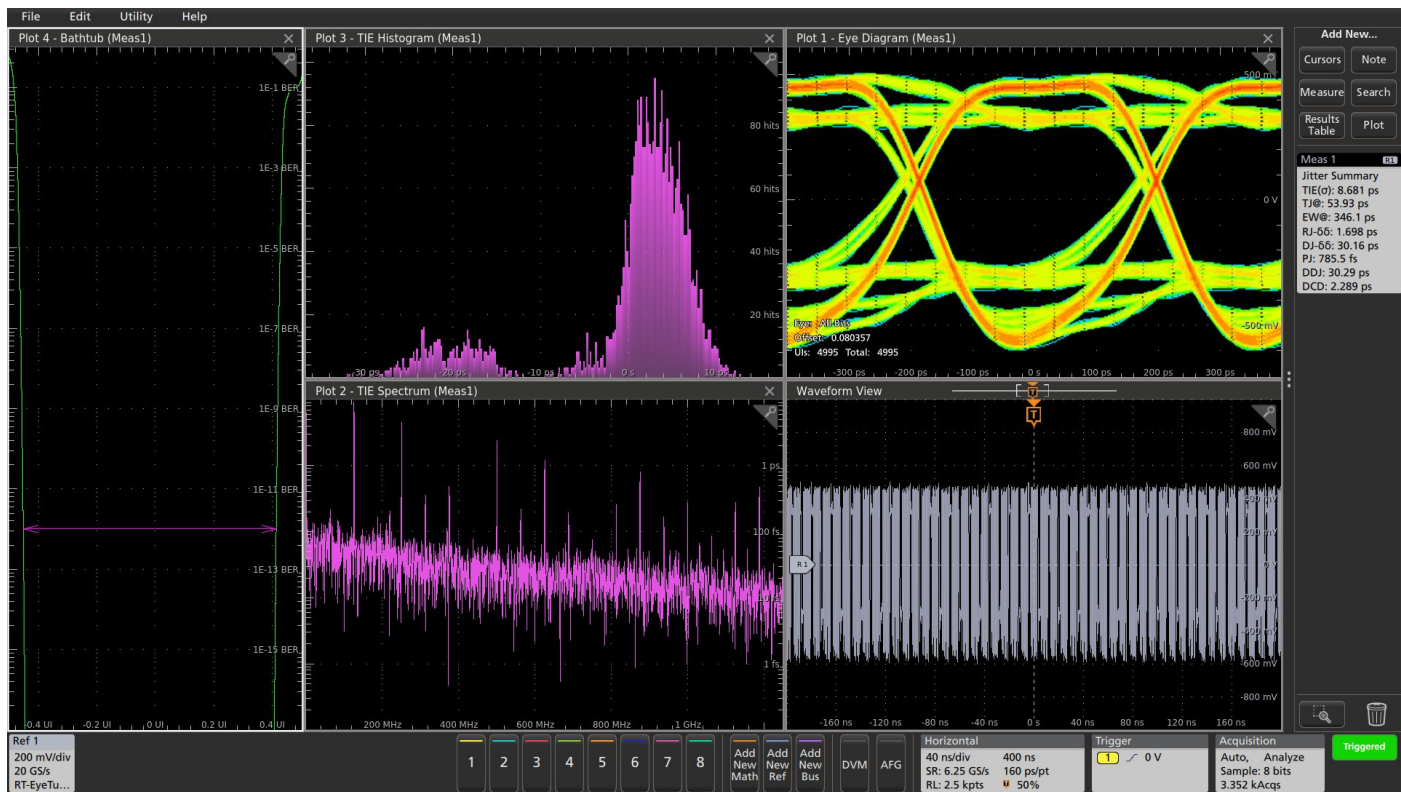


獨特的「抖動摘要」幾秒內就能提供裝置效能的完整檢視。

功率分析

5 系列 MSO 也已將選配的 5-PWR/SUP5-PWR 功率分析套件整合至示波器的自動量測系統，以提供快速且可重複的電源品質、諧波、切換損失、安全工作區 (SOA)、調變、漣波、磁性量測、效率、振幅與時序量測和扭轉率 (dv/dt 和 di/dt) 分析。

自動量測透過輕觸按鈕即可最佳化量測品質和重複性，不需要外部電腦或複雜的軟體設定。

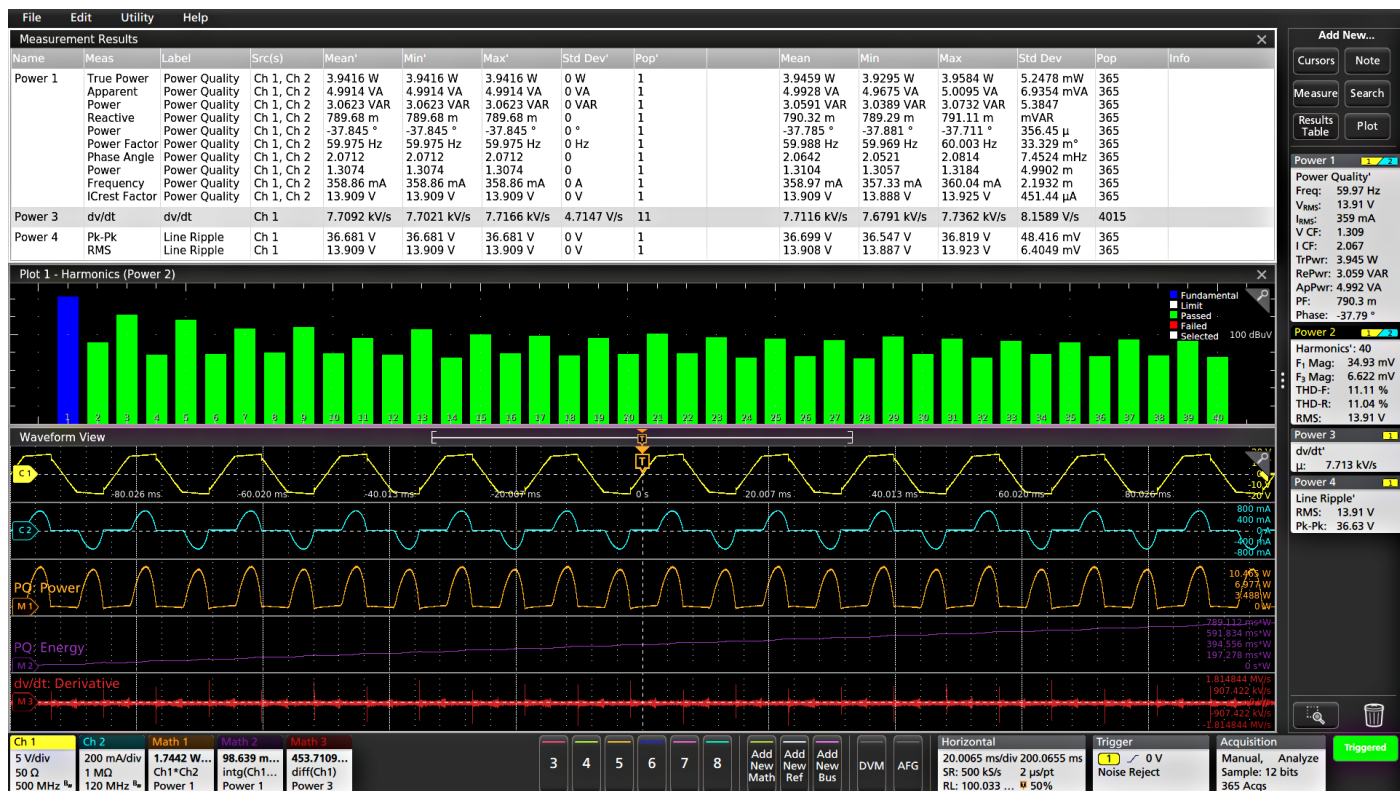

功率分析量測可顯示各種波形和繪圖。

符合需求的設計

連接能力

5 系列 MSO 提供數個連接埠，可用於將儀器連接至網路、直接連接至電腦或其他測試設備。

- 正面有兩個 USB 2.0 和一個 USB 3.0 主機埠，背面還有四個 USB 主機埠（兩個 2.0、兩個 3.0），可讓您輕鬆將螢幕擷取畫面、儀器設定與波形資料傳輸至 USB 大量儲存裝置。USB 滑鼠和鍵盤也可以連接至 USB 主機埠，以方便控制儀器和輸入資料。
- 背板的 USB 裝置埠很適合從電腦遙控示波器。
- 儀器背面的標準 10/100/1000BASE-T Ethernet 埠，可讓您輕鬆連接網路，並提供 LXI Core 2011 的相容性。
- 儀器背面的 DVI-D、顯示埠和 VGA 埠可讓您將螢幕匯出至外部監視器或投影機。



將 5 系列 MSO 連接至設計環境其餘部分時所需要的 I/O。

可改善合作的遠端操作

想要與遠方的設計團隊攜手合作嗎？

嵌入式 e*Scope® 功能可利用標準的網頁瀏覽器，透過網路連線快速控制示波器。只需輸入示波器的 IP 位址或網路名稱，瀏覽器中將出現一個網頁。從遠端控制示波器，彷彿親臨現場一樣。或者，您也可以利用 Microsoft Windows Remote Desktop™ 功能，直接連接至示波器來從遠端控制。

隨附業界標準的 TekVISA™ 通訊協定介面，可讓您使用和強化用於資料分析和文件記錄的 Windows 應用程式。隨附 IVI-COM 儀器驅動程式，可從外部電腦使用 LAN 或 USBTMC 連線，輕鬆與示波器通訊。



e*Scope 支援利用常用的網頁瀏覽器，輕鬆從遠端檢視和控制。

任意/函數產生器 (AFG)

5 系列 MSO 包含一個選配的整合式任意/函數產生器，非常適合模擬設計中的感應器訊號或增加雜訊以對訊號進行邊際測試。整合式函數產生器可針對正弦波、方波、脈衝波、斜波/三角波、直流、雜訊、sin(x)/x (正弦)、高斯、羅倫茲、指數上升/下降、半正弦波和心電波等，提供高達 50 MHz 的預定義波形輸出。任意波形產生器提供了 128 k 點的記錄長度，可從內部檔案位置或 USB 大容量儲存裝置載入已儲存的波形。5 系列 MSO 與 Tektronix ArbExpress 的 PC 式波形建立和編輯軟體相容，讓您可快速又輕鬆地建立複合波形。

數位電壓計 (DVM) 和觸發計頻器

5 系列 MSO 包含整合式 4 位數數位電壓計 (DVM) 和 8 位數觸發計頻器。任何類比輸入皆可使用已連接供通用示波器使用的相同探棒，以作為電壓計的來源。對於您所觸發的觸發事件，計數器提供非常精確的頻率讀數。DVM 和觸發計頻器都是免費提供，在您註冊產品時就會啟動。

加強型安全性選項

選配的 5-SEC 加強型安全性選項可提供可啟用/停用所有儀器之 I/O 連接埠與韌體升級的受密碼保護。此外，選項 5-SEC 也可透過確保清除內部記憶體的所有設定和波形資料，以符合美國國家工業安全計畫操作手冊 (NISPOM) DoD 5220.22-M 第 8 章的需求，以及美國國防安全局 NISPOM 範疇內分類系統認證和認可手冊，提供最高的安全性層級。這確保您可以自信地將儀器移至安全區域外。

即時協助

5 系列 MSO 附有許多實用的資源，讓您快速找到問題的解答，不必查閱手冊或瀏覽網站：

- 許多功能表都使用圖形和說明文字，可讓您快速一覽功能概要。
- 所有功能表的右上角都有問號圖示，可讓您直接跳到整合式輔助說明系統中適用於該功能表的部分。
- 「輔助說明」功能表包含簡短的使用者介面教學課程，讓新的使用者在幾分鐘內很快就能開始操作儀器。

Add Measurements configuration menu overview

Use this configuration menu to select measurements you want to take on waveforms and add the measurements to the Results bar.

To open the **Add Measurements** configuration menu, tap the **Add New... Measure** button in the **Analysis** controls area.

The **Add Measurements** configuration menu always opens on the **Standard** measurement tab. The listed tabs and measurements depend on the installed measurement options and the selected signal source.

To add a measurement, select the source, select the measurement, and either tap the **Add** button or double-tap the measurement. The measurement is added to the Results bar.

To change individual measurement settings, double-tap the Measurement badge to open a Measurement configuration menu. See [Measurement configuration menu overview](#).

Add Measurements configuration menu fields and controls

Field or control	Description
Measurement tabs	The tabs along the top organize measurements by their type. The Standard tab is the default set of measurements that are built in to the instrument. Other tabs are shown when you install measurement options.
Measurement description	Shows a graphic and short description of a selected measurement. Use this information to verify that the selected measurement is correct for what you want to measure.

ADD MEASUREMENTS

Standard Jitter

Rise Time
Rise Time is the time required for an edge to rise from the Base reference level (R_b) to the Top reference level (R_t). This measurement is made on each cycle in the record.

Source: Ch 1

AMPLITUDE MEASUREMENTS

TIMING MEASUREMENTS

- Period
- Data Rate
- Skew
- Fall Time
- Falling Slew Rate
- Negative Duty Cycle
- Frequency
- Positive Pulse Width
- Delay
- Phase
- Burst Width
- Time Outside Level
- Unit Interval
- Negative Pulse Width
- Rise Time
- Rising Slew Rate
- Positive Duty Cycle
- Setup Time

Horizontal: 400 ns/div, 4 μ s
SR: 6.25 GS/s, 160 ps/pt
RL: 25 kpts, 18%

Trigger: 1.72 V

Acquisition: Auto, Analyze
Sample: 8 bits
6.830 kAcqs

整合式輔助說明可快速解答您的問題，不必查閱手冊或上網查詢。

規格

除非另有註明，否則所有規格均有保證。除非另有註明，否則所有規格皆適用於所有機型。

機型概況

示波器

	MSO54	MSO56	MSO58
FlexChannel 輸入通道	4	6	8
類比通道數上限	4	6	8
數位通道上限 (使用選配邏輯探棒)	32	48	64
頻寬 (計算而得的上升時間)	350 MHz (1.15 ns)、500 MHz (800 ps)、1 GHz (400 ps)、2 GHz (225 ps)		
直流增益準確度	2 GHz 型號, 50 Ω : ±1.2%, (≤1 mV/格時為 ±2.0%), 高於 30°C 時衰減 0.1 %/°C 2 GHz 型號, 1 MΩ : ±1.0%, (≤1 mV/格時為 ±2.0%), 高於 30°C 時衰減 0.1 %/°C <2 GHz 型號, 50 Ω, 1 MΩ : ±1.0%, (≤1 mV/格時為 ±2.0%), 高於 30°C 時衰減 0.1 %/°C		
ADC 解析度	12 位元		
垂直解析度	8 位元 @ 6.25 GS/s 12 位元 @ 3.125 GS/s 13 位元 @ 1.25 GS/s (高解析度) 14 位元 @ 625 MS/s (高解析度) 15 位元 @ 312.5 MS/s (高解析度) 16 位元 @ ≤125 MS/s (高解析度)		
取樣率	所有類比/數位通道為 6.25 GS/s (160 解析度)		
記錄長度 (標準)	所有類比/數位通道為 62.5 M 點		
記錄長度 (購配)	所有類比/數位通道為 125 M 點		
波形擷取率	>500,000 wfms/秒		
任意/函數產生器 (選配)	13 個預先定義的波形類型, 提供高達 50 MHz 的輸出		
DVM	4 位數 DVM (註冊產品即可免費獲得)		
觸發計頻器	8 位數計頻器 (註冊產品即可免費獲得)		

垂直系統 - 類比通道

頻寬選擇 適用於您型號的 20 MHz、250 MHz 和全頻寬值

輸入耦合 直流、交流

輸入阻抗 50 Ω ± 1%
1 MΩ ± 1%, 14.5 pF ± 1.5 pF (2 GHz 型號)
1 MΩ ± 1%, 13.0 pF ± 1.5 pF (< 2 GHz 型號)

垂直系統 - 類比通道

輸入靈敏度範圍

1 M Ω	500 μ V/格至 10 V/格, 依 1-2-5 順序
50 Ω	500 μ V/格至 1 V/格, 依 1-2-5 順序
	附註: 500 μ V/格是 1mV/格的 2X 數位縮放。

最大輸入電壓

50 Ω : 5 V _{RMS} , 峰值 $\leq \pm 20$ V (DF $\leq 6.25\%$)
1 M Ω : 300 V _{RMS} , CAT II
1 M Ω 從 4.5 MHz 至 45 MHz 時衰減 20 dB/十進位 ;
從 45 MHz 至 450 MHz 時衰減 14 dB/十進位 ;
> 450 MHz, 5.5V _{RMS}

有效位元 (ENOB), 典型

2 GHz 型號, 高解析度模式,
50 Ω , 10 MHz 輸入和全螢幕 90%

頻寬	ENOB
1 GHz	7.0
250 MHz	7.8
20 MHz	8.7

< 2 GHz 型號, 高解析度模
式, 50 Ω , 10 MHz 輸入和
全螢幕 90%

頻寬	ENOB
1 GHz	7.6
500 MHz	7.9
350 MHz	8.2
250 MHz	8.1
20 MHz	8.9

產品規格表

垂直系統 - 類比通道

隨機雜訊, RMS, 典型

2 GHz 型號, 高解析度模式
(RMS)

2 GHz 型號 V/格	50 Ω			1 MΩ		
	1 GHz	250 MHz	20 MHz	500 MHz	250 MHz	20 MHz
≤1 mV/格 ⁴	66.8 μV	66.8 μV	27.2 μV	208 μV	117 μV	64.6 μV
2 mV/格 ⁵	96.9 μV	77.5 μV	28.5 μV	224 μV	117 μV	66.7 μV
5 mV/格 ⁶	202 μV	108 μV	37.4 μV	238 μV	133 μV	68.7 μV
10 mV/格	275 μV	147 μV	56.1 μV	277 μV	173 μV	83.6 μV
20 mV/格	469 μV	251 μV	106 μV	416 μV	278 μV	125 μV
50 mV/格	1.10 mV	589 μV	253 μV	916 μV	620 μV	271 μV
100 mV/格	2.75 mV	1.47 mV	602 μV	1.90 mV	1.36 mV	603 μV
1 V/格	18.4 mV	10.8 mV	4.68 mV	20.3 mV	14.6 mV	6.54 mV

1 GHz、500 MHz、350 MHz
型號, 高解析度模式 (RMS)

<2 GHz 型號 V/格	50 Ω					1 MΩ			
	1 GHz	500 MHz	350 MHz	250 MHz	20 MHz	500 MHz	350 MHz	250 MHz	20 MHz
≤1 mV/格 ⁷	254 μV	198 μV	141 μV	118 μV	70.0 μV	189 μV	143 μV	118 μV	64.8 μV
2 mV/格	255 μV	198 μV	143 μV	121 μV	70.4 μV	194 μV	145 μV	121 μV	66.0 μV
5 mV/格	262 μV	202 μV	150 μV	133 μV	72.8 μV	196 μV	152 μV	130 μV	69.6 μV
10 mV/格	283 μV	218 μV	169 μV	158 μV	79.8 μV	212 μV	167 μV	154 μV	78.2 μV
20 mV/格	357 μV	273 μV	222 μV	223 μV	102 μV	269 μV	214 μV	223 μV	104 μV
50 mV/格	677 μV	516 μV	436 μV	460 μV	196 μV	490 μV	410 μV	480 μV	207 μV
100 mV/格	1.61 mV	1.23 mV	1.02 mV	1.04 mV	464 μV	1.16 mV	964 μV	1.05 mV	475 μV
1 V/格	13.0 mV	9.88 mV	8.41 mV	8.94 mV	3.77 mV	13.6 mV	10.6 mV	11.1 mV	5.47 mV

位置範圍

±5 格

4 在 50 Ω 時, ≤1 mV/格的頻寬上限為 175 MHz。

5 在 50 Ω 時, 2 mV/格的頻寬上限為 350 MHz。

6 在 50 Ω 時, 5 mV/格的頻寬上限為 1.5 GHz。

7 在 50 Ω 時, 500 μV/格的頻寬上限為 250 MHz。

垂直系統 - 類比通道

偏移範圍, 最大值

2 GHz 型號

伏特/格設定	最大偏移範圍, 50Ω 輸入
500 μV/格 - 50 mV/格	±1 V
51 mV/格 - 99 mV/格	±(-10 * (伏特/格設定) + 1.5 V)
100 mV/格 - 500 mV/格	±10 V
501 mV/格 - 1 V/格	±(-10 * (伏特/格設定) + 15 V)

伏特/格設定	最大偏移範圍, 1MΩ 輸入
500 μV/格 - 63 mV/格	±1 V
64 mV/格 - 999 mV/格	±10 V
1 V/格 - 10 V/格	±100 V

≤ 1 GHz 型號

伏特/格設定	最大偏移範圍	
	50Ω 輸入	1MΩ 輸入
500 μV/格 - 63 mV/格	±1 V	±1 V
64 mV/格 - 999 mV/格	±10 V	±10 V
1 V/格 - 10 V/格	±10 V	±100 V

偏移準確度

±(0.005 X |偏移 - 位置| + 直流平衡)

串音 (通道隔離), 典型

具有相同伏特/格設定的任兩個通道為 ≥ 200:1 到額定頻寬

直流平衡

0.1 格, 含直流 - 50 Ω 示波器輸入阻抗 (50 Ω BNC 終止)

1 mV/格時為 0.2 格, 含直流 - 50 Ω 示波器輸入阻抗 (50 Ω BNC 終止)

500 μV/格時為 0.4 格, 含直流 - 50 Ω 示波器輸入阻抗 (50 Ω BNC 終止)

0.2 格, 含直流 - 1 MΩ 示波器輸入阻抗 (50 Ω BNC 終止)

500 μV/格時為 0.4 格, 含直流 - 1 MΩ 示波器輸入阻抗 (50 Ω BNC 終止)

垂直系統 - 數位通道

通道的數目

每台安裝的 TLP058 為 8 個數位輸入 (D7-D0) (換取一個類比通道)

垂直解析度

1 位元

最大輸入切換速度

500 MHz

最小可偵測脈波寬度, 典型

1 奈秒

臨界值

每個數位通道有一個臨界值

臨界值範圍

±40 V

臨界值解析度

10 mv

產品規格表

垂直系統 - 數位通道

臨界值精確度	± [100 mV + 校驗之後臨界值設定的 3%]
輸入磁滯, 典型	探棒頭為 100 mV
輸入動態範圍, 典型	$F_{in} \leq 200$ MHz 為 $30 V_{pp}$, $F_{in} > 200$ MHz 為 $10 V_{pp}$
絕對最大輸入電壓, 典型	±42 伏特峰值
最小電壓擺幅, 典型	400 mV 峰對峰
輸入阻抗, 典型	100 k Ω
探棒負載, 典型	2 pF

水平系統

時基範圍	200 ps/格到 1,000 s/格								
取樣率範圍	1.5625 S/s 至 6.25 GS/s (即時) 12.5 GS/s 至 500 GS/s (內插)								
記錄長度範圍									
標準	單一取樣增量中為 1 k 點至 62.5 M 點								
選項 5-RL-125M	125 M 點								
最高取樣率的最大期限	10 ms (標準) 或 20 ms (選配)								
時基延遲時間範圍	-10 分格至 5000 s								
偏移校正範圍	125 ns 到 +125 ns, 解析度為 40 ps								
時基準確度	任何 ≥ 1 ms 的時間間隔中為 $\pm 2.5 \times 10^{-6}$								
	<table border="1"><thead><tr><th>說明</th><th>規格</th></tr></thead><tbody><tr><td>原廠公差</td><td>$\pm 5.0 \times 10^{-7}$。校驗時, 任何 ≥ 1 ms 的時間間隔內為 23 °C 周圍溫度</td></tr><tr><td>溫度穩定性</td><td>$\pm 5.0 \times 10^{-7}$。在作業溫度下測試</td></tr><tr><td>晶體老化, 典型</td><td>$\pm 1.5 \times 10^{-6}$。在 1 年期間內, 25 °C 時的頻率公差變更</td></tr></tbody></table>	說明	規格	原廠公差	$\pm 5.0 \times 10^{-7}$ 。校驗時, 任何 ≥ 1 ms 的時間間隔內為 23 °C 周圍溫度	溫度穩定性	$\pm 5.0 \times 10^{-7}$ 。在作業溫度下測試	晶體老化, 典型	$\pm 1.5 \times 10^{-6}$ 。在 1 年期間內, 25 °C 時的頻率公差變更
說明	規格								
原廠公差	$\pm 5.0 \times 10^{-7}$ 。校驗時, 任何 ≥ 1 ms 的時間間隔內為 23 °C 周圍溫度								
溫度穩定性	$\pm 5.0 \times 10^{-7}$ 。在作業溫度下測試								
晶體老化, 典型	$\pm 1.5 \times 10^{-6}$ 。在 1 年期間內, 25 °C 時的頻率公差變更								

水平系統

差值時間測量準確度

$$DTA_{pp}(\text{typical}) = 10 \times \sqrt{\left(\frac{N}{SR_1}\right)^2 + \left(\frac{N}{SR_2}\right)^2 + \left(0.450 \text{ ps} + (1 \times 10^{-11} \times t_p)\right)^2} + TBA \times t_p$$

$$DTA_{RMS} = \sqrt{\left(\frac{N}{SR_1}\right)^2 + \left(\frac{N}{SR_2}\right)^2 + \left(0.450 \text{ ps} + (1 \times 10^{-11} \times t_p)\right)^2} + TBA \times t_p$$

(假設高斯濾波器響應所造成的邊緣形狀)

針對指定之儀器設定和輸入訊號計算差值時間量測準確度 (DTA) 的公式，假設為奈奎斯特 (Nyquist) 頻率以上的無意義訊號內容，其中：

SR_1 = 量測中第 1 點周圍的扭轉率 (第 1 個邊緣)

SR_2 = 量測中第 2 點周圍的扭轉率 (第 2 個邊緣)

N = 輸入 - 參照保證雜訊限制 (伏特 RMS)

TBA = 時基準確度或參考頻率錯誤

t_p = 差值時間量測期間 (秒)

 光圈不確定性

期間 ≤ 100 ms 的量測為 $\leq 0.450 \text{ ps} + (1 \times 10^{-11} \times \text{量測期間})_{RMS}$

類比通道之間的延遲，全頻寬，典型

任兩個通道的輸入阻抗設為 50 Ω ，且直流耦合等於伏特/格或高於 10 mV/格時為 ≤ 100 ps

類比和數位 FlexChannel 之間的延遲，典型

使用 TLP058 和 TPP1000/TPP0500B 且未套用頻寬限制時為 < 1 ns

任兩個數位 FlexChannel 之間的延遲，典型

320 ps

一個數位 FlexChannel 的兩個位元之間的延遲，典型

160 ps

觸發系統

觸發模式

自動、一般與單次

觸發耦合

DC、AC、高頻抑制 (衰減 > 50 kHz)、低頻抑制 (衰減 < 50 kHz) 及雜訊抑制 (降低靈敏度)

觸發延滯範圍

0 奈秒至 20 秒

觸發抖動，典型

取樣模式和邊緣類型觸發下 ≤ 5 pSRMS

邊緣類型觸發和 FastAcq 模式下 ≤ 7 pSRMS

非邊緣類型觸發模式下 ≤ 40 pSRMS

觸發系統

邊緣類型觸發靈敏度，直流耦合，典型

通道	範圍	規格
1 M Ω 通道 (所有型號)	0.5 mV/格至 0.99 mV/格	從直流到儀器頻寬為 4.5 格
	≥ 1 mV/格	5 mV 或 0.7 格較大者從直流到 500 MHz 或儀器 BW 較小者，以及 6 mV 或 0.8 格從 > 500 MHz 到儀器頻寬
50 Ω 通道, 1GHz, 500MHz, 350MHz 型號		5.6 mV 或 0.7 格較大者從直流到 500 MHz 或儀器 BW 較小者，以及 7 mV 或 0.8 格從 > 500 MHz 到儀器頻寬
50 Ω 通道, 2GHz 型號	0.5 mV/格至 0.99 mV/格	從直流到儀器頻寬為 3.0 格
	1 mV/格至 9.98 mV/格	從直流到儀器頻寬為 1.5 格
	≥ 10 mV/格	從直流到儀器頻寬為 < 1.0 格
市電頻率		固定

觸發位準範圍

訊號源	範圍
任何通道	距螢幕中央 ± 5 格
市電頻率	固定為約線路電壓的 50%

此規格適用於邏輯和脈波臨界值。

觸發計頻器

8 位數 (註冊產品即可免費獲得)

觸發類型

- 邊緣：** 任一通道上正、負，或任一斜率。耦合包括直流、交流、雜訊排斥、高頻排斥和低頻排斥
- 脈衝寬度：** 在正脈波或負脈波的寬度上觸發。事件可為時間或邏輯限定
- 逾時：** 在指定時段內維持為高、低或任一的事件上觸發。事件可為邏輯限定
- 矮波：** 穿越第一臨界值，但未在再次穿越第一臨界值之前穿越第二臨界值的脈衝上進行觸發。事件可為時間或邏輯限定
- 視窗：** 在兩個臨界值 (可由使用者調整) 所定義的視窗上，當事件進入、離開、停留在內或停留在外時觸發。事件可為時間或邏輯限定
- 邏輯：** 當邏輯碼型為真、為否或與時脈邊緣同時發生時觸發。針對所有定義為高、低或任意的輸入通道所指定的碼型 (AND、OR、NAND、NOR)。為真的邏輯碼型可為時間限定
- 設定 / 保持：** 任何輸入通道的時脈和資料之間，設定時間與保持時間違反兩者都出現時觸發
- 上升/下降時間：** 高或低於指定脈衝邊緣速率的觸發。斜率可為正向、負向或兩者任一。事件可為邏輯限定
- 序列：** 當 A 觸發在 C 事件上重設之後，在 B 事件發生 X 時間或發生 N 個事件時觸發。一般而言，A 和 B 觸發事件可設為任何觸發類型，但有幾個例外情形：不支援邏輯限定條件，如果 A 事件或 B 事件設為「設定/保持」，則另一個必須設為「邊緣」，且不支援乙太網路 和高速 USB (480 Mbps)
- 並列匯流排：** 在並列匯流排資料值上進行觸發。並列匯流排可以是 1 到 64 位元 (從數位和類比通道) 的大小。支援二進位和十六進位基數
- I²C 匯流排 (選項 5-SREMBD)：** I²C 匯流排上的 Start (起始)、Repeated Start (重複起始)、Stop (停止)、Missing ACK (ACK 遺失)、Address (位址, 7 或 10 位元)、Data (資料) 或 Address and Data (位址和資料) 觸發，高達 10 Mb/秒
- SPI 匯流排 (選項 5-SREMBD)：** SPI 匯流排上的 Slave Select (從屬選擇)、Idle Time (閒置時間) 或 Data (資料, 1-16 個字) 觸發，高達 20Mb/秒

觸發系統

RS-232/422/485/UART 匯流排 (選項 5-SRCOMP) :	Start Bit (起始位元)、End of Packet (封包結束)、Data (資料) 和 Parity Error (同位檢查錯誤) 觸發, 高達 15 Mb/秒
CAN 匯流排 (選項 5-SRAUTO) :	CAN 匯流排上的 Start of Frame (訊框起始)、Type of Frame (訊框類型, 資料、遠端、錯誤或超載)、Identifier (識別碼)、Data (資料)、Identifier and Data (識別碼及資料)、End of Frame (訊框結束)、Missing Ack (ACK 遺失) 及 Bit Stuff Error (位元填塞錯誤) 觸發, 高達 1 Mb/秒
CCAN FD 匯流排 (選項 5-SRAUTO) :	CAN FD 匯流排上的訊框起始、訊框類型 (資料、遠端、錯誤、超載)、識別碼 (標準或延伸)、資料 (1-8 位元組)、識別碼和資料、訊框結尾、錯誤 (遺失確認、位元填塞錯誤、FD 形狀錯誤、任何錯誤) 觸發, 高達 16 Mb/秒
LIN 匯流排 (選項 5-SRAUTO) :	LIN 匯流排上的 Sync (同步)、Identifier (識別碼)、Data (資料)、Identifier and Data (識別碼與資料)、Wakeup Frame (喚醒訊框)、Sleep Frame (睡眠訊框)、Error (錯誤) 觸發, 高達 1 Mb/秒
FlexRay 匯流排 (選項 5-SRAUTO) :	FlexRay 匯流排上的 Start of Frame (訊框起始)、Indicator Bits (指示位元, 一般、負載、Null、同步、啟動)、Frame ID (訊框識別碼)、Cycle Count (週期計數)、Header Fields (標頭欄位, 指示位元、識別碼、負載長度、標頭 CRC 及週期計數)、Identifier (識別碼)、Data (資料)、Identifier and Data (識別碼與資料)、End Of Frame (訊框終點) 及 Error (錯誤) 觸發, 高達 10 Mb/秒
SENT 匯流排 (選項 5-SRAUTOSEN)	Start of Packet (封包開始)、Fast Channel Status (快速通道狀態)、Data (資料) 和 CRC Error (CRC 錯誤) 觸發
USB 2.0 LS/FS/HS 匯流排 (選項 5-SRUSB2) :	USB 匯流排上的 Sync (同步)、Reset (重設)、Suspend (暫停)、Resume (恢復)、End of Packet (封包結束)、Token (Address) Packet (代符 (位址) 封包)、Data Packet (資料封包)、Handshake Packet (交握封包)、Special Packet (特殊封包) 及 Error (錯誤) 觸發, 高達 480 Mb/秒
乙太網路匯流排 (選項 5-SRENET) :	10BASE-T 及 100BASE-TX 匯流排上的「訊號起始」、「MAC 位址」、「MAC Q 標籤」、「MAC 長度/類型」、「MAC 資料」、「IP 標頭」、「TCP 標頭」、「TCP/IPV4 資料」、「封包結束」和「FCS (CRC) 錯誤」觸發
音訊 (I ² S、LJ、RJ、TDM) 匯流排 (選項 5-SRAUDIO) :	在文字選取、圖框同步或資料上進行觸發。I ² S/LJ/RJ 的最大資料傳輸速率為 12.5 Mb/秒。TDM 的最大資料速率為 25 Mb/秒
MIL-STD-1553 匯流排 (選項 5-SRAERO) :	MIL-STD-1553 匯流排上的同步、指令 (傳輸/接收位元、同位檢查、子位址/模式、文字計數/模式計數、RT 位址)、狀態 (同位檢查、訊息錯誤、儀器、服務要求、已接收廣播指令、忙碌、子系統旗標、動態匯流排控制接受、終端旗標)、資料、時間 (RT/IMG) 和錯誤 (同位檢查錯誤、同步錯誤、Manchester 錯誤、非連續資料) 觸發
ARINC 429 匯流排 (選項 5-SRAERO) :	ARINC 429 匯流排上的文字啟始、標籤、資料、標籤和資料、文字結束和錯誤 (任何錯誤、同位檢查錯誤、文字錯誤、差距錯誤) 觸發, 高達 1Mb/秒

擷取系統

取樣	擷取取樣值
峰值檢測	在所有掃描速度下擷取最窄 640 ps 的突波
平均值	從 2 個到 10,240 個波形
包封	最少至最多包封可反映隨多次擷取所累積的「波峰偵測」資料

擷取系統

高解析度 對每個取樣率套用唯一的有限脈衝響應 (FIR) 濾波器，將會盡力為該取樣率保持最大頻寬，同時避免頻疊，針對所選取的取樣率，還會從示波器放大器和 ADC 移除高於可用頻寬的雜訊。
高解析度模式一定會提供至少 12 位元的垂直解析度，在 ≤125 MS/s 取樣率之下，將會一路擴充至 16 位元的垂直解析度。

FastAcq® FastAcq 可擷取 >500,000 wfms/s，將儀器的動態訊號分析與偶發事件擷取能力最佳化。

捲動模式 在處於自動觸發模式時，以由右至左的捲動動作和 40 ms/格和更慢的時基速度，在顯示畫面上捲動連續波形點。

FastFrame™ 將擷取記憶體分割為數個區段。
最大觸發率 >5,000,000 個波形/秒
最小訊框大小 = 50 點
訊框數上限：如果訊框大小 ≥ 1,000 點，訊框數上限 = 記錄長度 / 訊框大小。如果訊框為 50 點，訊框數上限 = 950,000

波形量測

游標類型 波形、垂直線條、水平線條及水平加垂直線條

直流電壓測量準確度, 平均擷取模式	量測類型	直流準確度 (以伏特數表示)
	≥ 16 個波形的平均值	±(直流增益準確度 * 讀數 - (偏移 - 位置) + 偏移準確度 + 0.1 * V/格設定)
	自相同示波器設定及周圍環境條件下所擷取 ≥16 個波形，其中任兩者間的差值電壓	±(直流增益準確度 * 讀數 + 0.05 格)

自動量測 36 個，而一次可顯示的數目不限，可顯示為個別量測徽章，或一起顯示在量測結果表中

振幅量測 振幅、最大值、最小值、峰對峰、正過衝、負過衝、平均值、RMS、交流 RMS、頂點、底和區域

時序量測 週期、頻率、單位間隔、資料速率、正脈波寬度、負脈波寬度、偏移、延遲、上升時間、下降時間、相位、上升扭轉率、下降扭轉率、爆發寬度、正工作週期、負工作週期、時間外部位準、設定時間、保持時間、期間 N 期、高時間和低時間

自動抖動量測 (標準) TIE 和相位雜訊

量測統計 平均值、標準差、最大值、最小值和母體。目前擷取和所有擷取都會有統計值

參考位準 可指定以百分比或單位，顯示自動量測的使用者定義的參考位準。對於所有量測，參考位準可設為全域，而對每個量測，可設為依訊號源或唯一

閘控 利用螢幕或波形游標，將擷取當中發生的特定事件隔離進行測量。對於所有量測，閘控可設為全域，而對每個量測，可設為唯一

量測繪圖 時間趨勢、分佈圖和頻譜繪圖適用於所有標準量測

波形量測

抖動分析 (選項 5-DJA、SUP5-DJA) 增加下列項目：

量測	抖動摘要、TJ@BER、RJ- $\delta\delta$ 、DJ- $\delta\delta$ 、PJ、RJ、DJ、DDJ、DCD、SRJ、J2、J9、NPJ、F/2、F/4、F/8、眼圖高度、眼圖高度@BER、眼圖寬度、眼圖寬度@BER、眼圖高、眼圖低、Q 因數、位元高、位元低、位元振幅、直流共模、交流共模 (峰對峰)、差動交叉、T/nT 比、SSC 頻率偏移、SSC 調變率
量測繪圖	眼圖和抖動浴缸

功率分析 (選項 5-PWR、SUP5-PWR) 增加下列項目：

量測	輸入分析 (頻率、 V_{RMS} 、 I_{RMS} 、電壓和電流波峰因數、實功率、視在功率、無功功率、功率因數、相位角和諧波)、振幅分析 (週期振幅、週期波峰、週期波谷、週期最大值、週期最小值、週期峰對峰)、時序分析 (週期、頻率、負工作週期、正工作週期、負脈波寬度、正脈波寬度)、切換分析 (切換損失、 dv/dt 、 di/dt 、安全工作區和 R_{DSon})、磁性分析 (電感、I vs. Intg(V)、磁性損失、詞性屬性) 和輸出分析 (線性漣波、切換漣波和效率)
量測繪圖	諧波長條圖、切換損失軌跡圖和安全工作區

波形數學運算

數學運算波形數	無限制
代數	對波形和常數進行加、減、乘、除
代數式	定義多種代數式，包括波形、純量、使用者可調整變數及參數量測結果。使用複雜的方程式對數學運算執行數學運算。例如 (Integral (CH1 - Mean(CH1)) X 1.414 X VAR1)
數學函數	反推、積分、微分、平方根、指數、Log 10、Log e、Abs、上限、下限、最小值、最大值、度數、弧度、Sin、Cos、Tan、ASin、ACos 和 ATan
關聯性	布林比較結果 >、<、 \geq 、 \leq 、= 和 \neq
邏輯	AND、OR、NAND、NOR、XOR 和 EQV
濾波函數	使用者可定義濾波器。使用者指定內含濾波器係數的檔案
快速傅立葉轉換函數	頻譜振幅和相位，實際和假象 (imaginary) 頻譜
快速傅立葉轉換垂直單位	振幅：線性和對數 (毫瓦分貝數) 相位：度數、弧度和群延遲
快速傅立葉轉換窗函數	Hanning、Rectangular、Hamming、Blackman-Harris、FlatTop2、Gaussian、Kaiser-Bessel 和 TekExp

產品規格表

搜尋

搜尋次數	無限制
搜尋類型	搜尋很長的記錄，找出所有符合使用者指定準則的項目，包括邊緣、脈波寬度、逾時、矮波脈波、視窗違反、邏輯碼型、設定/保持違反、上升/下降時間，以及匯流排通訊協定事件。搜尋結果可在波形檢視中或結果表中檢視。

顯示器

顯示器類型	15.6 英寸 (395 公釐) TFT 液晶彩色顯示器
螢幕 解析度	1,920 水平 × 1,080 垂直像素 (高解析度)
顯示模式	重疊：軌跡彼此重疊的傳統示波器螢幕 堆疊：每個波形放在自己切片內的顯示模式，且可利用完整 ADC 範圍，但外觀上仍與其他波形隔開
縮放	所有波型和繪圖視圖中都支援水平和垂直縮放。
內插法	Sin(x)/x 和線性
波形樣式	向量、點、可變持續累積和無限持續累積
方格圖	柵 (極)、時間、完整和無
調色盤	正常和反向
格式	YT、XY 和 XYZ

任意/函數產生器 (選配)

函數類型	任意、正弦波、方波、脈波、斜波、三角形、直流層、高斯、羅倫茲、指數上升/下降、sin(x)/x、隨機雜訊、Haversine 波、Cardiac 波
------	--

正弦波形

頻率範圍	0.1 Hz 至 50 MHz
頻率設定解析度	0.1 Hz
頻率準確度	130 ppm (頻率 ≤ 10 kHz), 50 ppm (頻率 > 10 kHz)
振幅範圍	20 mV _{pp} 至 5 V _{pp} 進入 Hi-Z ; 10 mV _{pp} 至 2.5 V _{pp} 進入 50 Ω
振幅平坦度, 典型	1 kHz 時為 ±0.5 dB < 20 mV _{pp} 振幅在 1 kHz 時為 ±1.5 dB
總諧波失真, 典型	振幅 ≥ 200 mV _{pp} 進入 50 Ω 負載時為 1% 振幅 > 50 mV 「且」 < 200 mV _{pp} 進入 50 Ω 負載時為 2.5%
無寄生動態範圍, 典型	40 分貝 (V _{pp} ≥ 0.1 V) ; 30 dB (V _{pp} ≥ 0.02 V), 50 Ω 負載

方波和脈波波形

頻率範圍	0.1 Hz 至 25 MHz
頻率設定解析度	0.1 Hz

任意/函數產生器 (選配)

頻率準確度	130 ppm (頻率 ≤ 10 kHz), 50 ppm (頻率 > 10 kHz)
振幅範圍	20 mV _{pp} 至 5 V _{pp} 進入 Hi-Z ; 10 mV _{pp} 至 2.5 V _{pp} 進入 50 Ω
工作週期範圍	10% - 90% 或 10 ns 最小脈波, 以較大者為準
	開啟和關閉時都會套用最小脈波時間, 所以頻率較高時會降低最大工作週期, 以維持 10 ns 關閉時間
工作週期解析度	0.1%
最小脈波寬度, 典型	10 ns。這是開啟或關閉期間的最小時間。
上升/下降時間, 典型	5 ns, 10% - 90%
脈波寬度解析度	100 ps
過衝, 典型	大於 100 mV _{pp} 的訊號階為 < 6%
	這會套用至正向轉換 (+過衝) 的過衝和負向 (-過衝) 轉換的過衝
不對稱, 典型	±1% ±5 ns (在 50% 工作週期)
抖動, 典型	< 60 ps TIE _{RMS} , ≥ 100 mV _{pp} 振幅, 40%-60% 工作週期
<hr/>	
斜波和三角波形	
頻率範圍	0.1 Hz 至 500 kHz
頻率設定解析度	0.1 Hz
頻率準確性	130 ppm (頻率 ≤ 10 kHz), 50 ppm (頻率 > 10 kHz)
振幅範圍	20 mV _{pp} 至 5 V _{pp} 進入 Hi-Z ; 10 mV _{pp} 至 2.5 V _{pp} 進入 50 Ω
變動對稱	0% - 100%
對稱解析度	0.1%
<hr/>	
直流位準範圍	±2.5 V 進入 Hi-Z ±1.25 V 進入 50 Ω
<hr/>	
隨機雜訊振幅範圍	20 mV _{pp} 至 5 V _{pp} 進入 Hi-Z 10 mV _{pp} 至 2.5 V _{pp} 進入 50 Ω
<hr/>	
Sin(x)/x	
最高頻率	2 MHz
<hr/>	
高斯脈波、Haversine 脈波和 Lorentz 脈波	
最高頻率	5 MHz
<hr/>	
Lorentz 脈波	
頻率範圍	0.1 Hz 至 5 MHz
振幅範圍	20 mV _{pp} 至 2.4 V _{pp} 進入 Hi-Z 10 mV _{pp} 至 1.2 V _{pp} 進入 50 Ω

產品規格表

任意/函數產生器 (選配)

Cardiac 波

頻率範圍	0.1 Hz 至 500 kHz
振幅範圍	20 mV _{pp} 至 5 V _{pp} 進入 Hi-Z 10 mV _{pp} 至 2.5 V _{pp} 進入 50 Ω

任意

記憶體深度	1 至 128 k
振幅範圍	20 mV _{pp} 至 5 V _{pp} 進入 Hi-Z 10 mV _{pp} 至 2.5 V _{pp} 進入 50 Ω
重複率	0.1 Hz 至 25 MHz
取樣率	250 MS/s

訊號振幅精確度 $\pm[(\text{峰對峰振幅設定的 } 1.5\%) + (\text{絕對直流偏移設定的 } 1.5\%) + 1 \text{ mV}]$ (頻率 = 1 kHz)

訊號振幅解析度
1 mV (Hi-Z)
500 μ V (50 Ω)

正弦波和斜波頻率準確度
 1.3×10^{-4} (頻率 ≤ 10 kHz)
 5.0×10^{-5} (頻率 > 10 kHz)

直流偏移範圍
 ± 2.5 V 進入 Hi-Z
 ± 1.25 V 進入 50 Ω

DC 偏移準確度
1 mV (Hi-Z)
500 μ V (50 Ω)

直流偏移精確度
 $\pm[(\text{絕對偏移電壓設定的 } 1.5\%) + 1 \text{ mV}]$
從環境溫度 25 °C 開始，每改變 10 °C 會增加 3 mV 的不確定性

數位伏特錶 (DVM)

量測類型 直流、交流_{RMS} + 直流、交流_{RMS}、

電壓解析度 4 位數

數位伏特錶 (DVM)

電壓準確度

直流： $\pm(1.5\% * |\text{讀取} - \text{偏移} - \text{位置}|) + (0.5\% * |(\text{偏移} - \text{位置})|) + (0.1 * \text{伏特/格})$

高於 30 °C 時衰減 |讀數 - 偏移 - 位置| 的 0.100%/°C

在距離螢幕中央 ± 5 格內的訊號

交流： $\pm 2\%$ (40 Hz 至 1 kHz) 且在 40Hz 至 1kHz 範圍之外沒有諧波含量

交流，典型： $\pm 2\%$ (20 Hz 至 10 kHz)

進行交流量測時，輸入通道垂直設定必須能夠讓 V_{PP} 輸入訊號涵蓋 4 和 10 格之間的内容，且必須在螢幕上完全呈現

觸發計頻器

準確度

$\pm(1 \text{ 計數} + \text{時基準確度} \times \text{輸入頻率})$

訊號必須至少為 8 mV_{pp} 或 2 格，以較大者為準。

最大輸入頻率

類比通道的最大頻寬

訊號必須至少為 8 mV_{pp} 或 2 格，以較大者為準。

解析度

8 位元

處理器系統

主機處理器

Intel i5-4400E, 2.7 GHz, 64 位元, 雙核心處理器

內部儲存

≥ 80 GB。外形規格是含 SATA-3 介面的 80 公釐 m.2 卡

作業系統

安裝了選項 5-WIN 的 Closed Linux

儀器：Microsoft Windows 10⁸

搭載 Microsoft Windows 10 OS 的固態硬碟 (SSD) (選項 5-WIN) ≥ 480 GB SSD。外形規格是含 SATA-3 介面的 2.5 英吋 SSD。此磁碟機可由客戶安裝，已內建 Microsoft Windows 10 Enterprise IoT 2016 LTSC (64 位元) 作業系統

輸入輸出埠

DisplayPort 接頭

20 針 DisplayPort 接頭

DVI 接頭

29 針 DVI-D 接頭，可連接外部監視器或投影機以顯示示波器畫面

VGA

DB-15 母接頭，可連接至外部顯視器或投影機來顯示示波器内容

探棒補償器訊號，典型

連線：接頭位於儀器的右下方

振幅：0 至 2.5 V

⁸ 選項 5-WIN 不適用於 MSO58LP 儀器。

產品規格表

輸入輸出埠

頻率：	1 kHz
電源阻抗：	1 k Ω

外部參考輸入	時基系統可對外部 10 MHz 參考進行相位鎖定 (± 4 ppm)
--------	---

USB 介面 (主機、裝置埠)	前面板 USB 主機埠：兩個 USB 2.0 高速埠、一個 USB 3.0 超高速埠 ，後面板 USB 主機埠：兩個 USB 2.0 高速埠、兩個 USB 3.0 超高速埠 背面板 USB 裝置埠：一個 USB 3.0 超高速裝置埠，可支援 USBTMC
-----------------	---

乙太網路介面	10/100/1000 Mb/秒
--------	------------------

輔助輸出	背板 BNC 接頭。可配置輸出，在示波器觸發、內部示波器參考時脈輸出，或 AFG 同步脈波時，提供正或負脈波輸出
------	--

特性	限制
V _{out} (HI)	≥ 2.5 V 開放式電路； ≥ 1.0 V 進入 50 Ω 負載至接地
V _{out} (LO)	≤ 0.7 V 進入 ≤ 4 mA 負載； ≤ 0.25 V 進入 50 Ω 負載至接地

Kensington 防盜鎖	背板安全插槽連接至標準 Kensington 防盜鎖
----------------	----------------------------

LXI	等級：LXI Core 2011 版本：1.4
-----	----------------------------

電源

電源

功率消耗	最大 400 瓦
來源電壓	100 - 240 V $\pm 10\%$ 時為 50 Hz 至 60 Hz $\pm 10\%$ 115 V $\pm 10\%$ 時為 400 Hz $\pm 10\%$

外觀特性

尺寸	高度：支腳摺疊、提把向後時，12.2 英吋 (309 公釐) 高度：支腳摺疊、提把朝上時，14.6 英吋 (371 公釐) 寬度：兩端提把之間 17.9 英吋 (454 公釐) 長度：從支腳後端到旋鈕前端、提把朝上時，8.0 英吋 (205 公釐) 長度：支腳摺疊、提把向後時，11.7 英吋 (297.2 公釐)
----	---

重量	< 25 磅 (11.4 公斤)
----	------------------

冷卻	儀器右側 (從儀器正面看時) 和背面需要淨空 2.0 英吋 (50.8 公釐)，冷卻效果才足夠
----	---

機架安裝配置	7U
--------	----

環境規格

溫度

操作中	+0 °C 至 +50 °C (32 °F 至 122 °F)
非操作中	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 140 °F)

濕度

操作中	在低於 +40°C 時為 5% 至 90% 的相對濕度 (% RH) 5% 至 55% 相對濕度之溫度超過 +40 °C、最高溫達 +50 °C，非冷凝溫度，而且必須符合最高濕球溫度 +39 °C
非操作中	在低於 +40°C 時為 5% 至 90% 的相對濕度 (% RH) 5% 至 39% 相對濕度之溫度超過 +40 °C、最高溫達 +50 °C，非冷凝溫度，而且必須符合最高濕球溫度 +39 °C

高度

作業中	高達 3,000 公尺 (9,843 英尺)
非作業中	高達 12,000 公尺 (39,370 英尺)

EMC、環境和安全

法規	歐盟的 CE 標記，及美國和加拿大核准的 UL
----	-------------------------

軟體

軟體

IVI 驅動程式	為如 LabVIEW、LabWindows/CVI、Microsoft .NET 及 MATLAB 等常見應用軟體提供一個標準的儀器編程介面。
e*Scope®	使用網路連接透過標準的網頁瀏覽器來控制示波器。只需輸入示波器的 IP 位址或網路名稱，瀏覽器中將出現一個網頁。您可直接從 Web 瀏覽器傳輸與儲存設定、波形、量測和螢幕影像，或進行即時控制變更示波器上的設定。
LXI 網頁介面	只要在瀏覽器的位址列中，輸入示波器的 IP 位址或網路名稱，即可透過標準網頁瀏覽器連接至示波器。此種網頁介面可透過 e*Scope 網頁式遠端控制功能，檢視儀器狀態與配置、網路設定的狀態與修改，並進行儀器控制。所有網頁互動均符合 LXI Core (1.4 版) 規格。

訂購資訊

使用下列步驟選取符合量測需求的儀器和選項。

步驟 1

首先，根據您需要的 FlexChannel 輸入通道數目，選取 5 系列 MSO 型號。每個 FlexChannel 輸入通道皆支援 1 個類比或 8 個數位輸入訊號，並可交互使用。

機型	FlexChannel 數目
MSO54	4
MSO56	6
MSO58	8

每台儀器都包括

- 每個 FlexChannel 一支被動類比探棒：
 - TPP0500B 500MHz 探棒 350 MHz 或 500 MHz 頻寬的型號
 - TPP1000 1GHz 探棒 1 GHz 或 2 GHz 頻寬的型號
- 安裝和安全手冊 (英文、日文和簡體中文版)
- 整合式線上說明
- 附有整合式配件包的前外蓋
- 滑鼠
- 電源線
- 校驗證書記載了國家計量機構 (NMI) 和 ISO9001/ISO17025 品質系統註冊的可追溯性
- 三年保固，含儀器的所有零件及人力。一年保固，含隨附探棒的所有零件及人工

步驟 2

選取您需要的類比通道頻寬來配置示波器

立即選擇以下其中一個頻寬選項來選擇您需要的頻寬。您稍後可以購買升級套件來升級。

頻寬選項	頻寬
5-BW-350	350 MHz
5-BW-500	500 MHz
5-BW-1000	1 GHz
5-BW-2000	2 GHz

步驟 3

增加儀器功能

儀器功能可以隨儀器一起訂購，也可以稍後再以升級套件來訂購。

儀器選項	內建功能
5-RL-125M	將記錄長度延長至 125 M 點/通道
5-WIN	增加具有 Microsoft Windows 10 作業系統授權的移動式 SSD
5-AFG	增加任意/函數產生器
5-SEC ⁹	儀器解除機密和可啟用與停用所有 USB 連接埠與韌體升級之受密碼保護的加強型安全性。

步驟 4

增加可選串列匯流排觸發、解碼和搜尋功能

立即從這些串列分析選項中選擇您需要的串列支援。您稍後可以購買升級套件來升級。

儀器選項	支援的串列匯流排
5-SRAERO	航太 (MIL-STD-1553、ARINC 429)
5-SRAUDIO	音訊 (I ² S、LJ、RJ、TDM)
5-SRAUTO	汽車 (CAN、CAN FD、LIN、FlexRay)
5-SRAUTOSEN	汽車感應器 (SENT)
5-SRCOMP	電腦 (RS-232/422/485/UART)
5-SREMBD	嵌入式 (I ² C、SPI)
5-SRENET	乙太網路 (10BASE-T、100BASE-TX)
5-SRUSB2	USB (USB2.0 LS、FS、HS) ¹⁰

差動串列匯流排呢？請務必查看 *增加類比探棒和轉接器* 中的差動探棒。

步驟 5

增加選配串列匯流排相容性測試

立即從這些選項中選擇您需要的串列相容性測試套件。您稍後可以購買升級套件來升級。

儀器選項	支援的串列匯流排
5-CMAUTOEN	汽車乙太網路 (100BASE-T1)。需要選項 5-WIN (具有 Microsoft Windows 10 作業系統的 SSD)

⁹ 您必須在購買儀器的同時一併選購此選項。無法作為升級提供。

¹⁰ 只有 ≥1 GHz 頻寬的型號才支援 USB 高速

步驟 6

增加選配分析能力

儀器選項	進階分析
5-DJA	進階抖動和眼圖分析
5-PWR	電源量測與分析
5-PS2 ¹¹	電源解決方案套件 (5-PWR、THDP0200、TCP0030A、067-1686-xx 偏移校正治具)

步驟 7

增加數位探棒

只要將 TLP058 邏輯探棒連接至 FlexChannel 輸入，即可將任何 FlexChannel 輸入通道配置為八個數位通道。您可以與儀器一起或單獨訂購 TLP058 探棒。

針對此儀器	訂購	若要新增
MSO54	1 至 4 支 TLP058 探棒	8 至 32 個數位通道
MSO56	1 至 6 支 TLP058 探棒	8 至 48 個數位通道
MSO58	1 至 8 支 TLP058 探棒	8 至 64 個數位通道

¹¹ 您必須在購買儀器的同時一併選購此選項。無法作為升級提供。

步驟 8

增加類比探棒和轉接器

增加其他建議的探棒和轉接器

建議的探棒 / 轉接器	說明
TAP1500	1.5 GHz TekVPI® 主動單端電壓探棒, ± 8 V 差動輸入電壓
TAP2500	2.5 GHz TekVPI® 主動單端電壓探棒, ± 4 V 差動輸入電壓
TCP0030A	30 A 交流/直流 TekVPI® 電流探棒, 120 MHz 頻寬
TCP0020	20 A 交流/直流 TekVPI® 電流探棒, 50 MHz 頻寬
TCP0150	150 A 交流/直流 TekVPI® 電流探棒, 20 MHz 頻寬
TRCP0300	30 MHz 交流電流探棒, 250 mA 至 300 A
TRCP0600	30 MHz 交流電流探棒, 500 mA 至 600 A
TRCP3000	16 MHz 交流電流探棒, 500 mA 至 3000 A
TDP0500	500 MHz TekVPI® 差動電壓探棒, ± 42 V 差動輸入電壓
TDP1000	1 GHz TekVPI® 差動電壓探棒, ± 42 V 差動輸入電壓
TDP1500	1.5 GHz TekVPI® 差動電壓探棒, ± 8.5 V 差動輸入電壓
TDP3500	3.5 GHz TekVPI® 差動電壓探棒, ± 2 V 差動輸入電壓
THDP0100	± 6 kV, 100 MHz TekVPI® 高壓差動探棒
THDP0200	± 1.5 kV, 200 MHz TekVPI® 高壓差動探棒
TMDP0200	± 750 V, 200 MHz TekVPI® 高壓差動探棒
TIVH02	隔離探棒; 200 MHz, ± 2500 V, TekVPI, 3 公尺纜線
TIVH02L	隔離探棒; 200 MHz, ± 2500 V, TekVPI, 10 公尺纜線
TIVH05	隔離探棒; 500 MHz, ± 2500 V, TekVPI, 3 公尺纜線
TIVH05L	隔離探棒; 500 MHz, ± 2500 V, TekVPI, 10 公尺纜線
TIVH08	隔離探棒; 800 MHz, ± 2500 V, TekVPI, 3 公尺纜線
TIVH08L	隔離探棒; 800 MHz, ± 2500 V, TekVPI, 10 公尺纜線
TIVM1	隔離探棒; 1 GHz, ± 50 V, TekVPI, 3 公尺纜線
TIVM1L	隔離探棒; 1 GHz, ± 50 V, TekVPI, 10 公尺纜線
TPP0502	500 MHz, 2X TekVPI® 被動電壓探棒, 12.7 pF 輸入電容
TPP0850	2.5 kV, 800 MHz, 50X TekVPI® 被動高壓探棒
P6015A	20 kV, 75 MHz 高壓被動探棒
TPA-BNC ¹²	TekVPI® 至 TekProbe™ BNC 轉接器
TEK-DPG	TekVPI 偏移校正脈波產生器訊號源
067-1686-xx	功率譜波量測偏移校正和校驗治具

要找其他探棒嗎？請利用 www.tek.com/probes 上的探棒選擇器工具。

¹² 建議將現有的 TekProbe 探棒連接至 5 系列 MSO。

步驟 9

增加配件

增加出差或安裝配件

可選配件	說明
HC5	硬質攜帶箱
RM5	框架組件

步驟 10

選取電源線選項

電源線選項	說明
A0	北美地區電源插頭 (115 V, 60 Hz)
A1	歐洲通用電源插頭 (220 V, 50 Hz)
A2	英國電源插頭 (240 V, 50 Hz)
A3	澳洲電源插頭 (240 V, 50 Hz)
A5	瑞士電源插頭 (220 V, 50 Hz)
A6	日本電源插頭 (100 V、50/60 Hz)
A10	中國電源插頭 (50 Hz)
A11	印度電源插頭 (50 Hz)
A12	巴西電源插頭 (60 Hz)
A99	無電源線

步驟 11

增加延長服務和校驗選項

服務選項	說明
T3	總計三年的保護方案, 包含折舊或破損零件的維修或更換、意外損壞以及 ESD 或 EOS 預防性維護。包括 5 天的處理時間以及優先客戶支援服務。
T5	總計五年的保護方案, 包含折舊或破損零件的維修或更換、意外損壞以及 ESD 或 EOS 預防性維護。包括 5 天的處理時間以及優先客戶支援服務。
R5	標準保固期可展期至 5 年。涵蓋零件、人工及國內 2 日運送。保證保固範圍以外的迅速維修時間。所有維修均包括校驗與更新。無繁瑣手續 - 一通電話立即處理。
C3	校驗服務 3 年。包括在適用情況下所建議校準的可追溯校準或功能驗證。測試範圍包括初始校正, 外加 2 年的校正測試範圍。
C5	校驗服務 5 年。包括在適用情況下所建議校準的可追溯校準或功能驗證。測試範圍包括初始校正, 外加 4 年的校驗測試範圍。
D1	校驗資料報告
D3	校驗資料報告 3 年 (含選項 C3)
D5	校驗資料報告 5 年 (含選項 C5)

購買後的功能升級

日後新增功能升級

5 系列 MSO 產品提供多種方法可於首次購買後輕易新增其功能。節點鎖定授權永久允許單一產品的選配功能。浮動授權可讓已啟用授權的選項輕易地在相容的儀器之間移動。

升級功能	節點鎖定授權升級	浮動授權升級	說明
新增儀器功能	SUP5-AFG	SUP5-AFG-FL	新增任意函數產生器
	SUP5-RL-125M	SUP5-RL-125M-FL	將記錄長度延長至 125Mpts/通道
	SUP5-WIN	N/A	新增已安裝 Windows 10 授權的可卸式 SSD
新增通訊協定分析	SUP5-SRAERO	SUP5-SRAERO-FL	航太串列觸發和分析 (MIL-STD-1553、ARINC 429)
	SUP5-SRAUDIO	SUP5-SRAUDIO-FL	音訊串列觸發和分析 (I ² S、LJ、RJ、TDM)
	SUP5-SRAUTO	SUP5-SRAUTO-FL	汽車串列觸發和分析 (CAN、CAN FD、LIN、FlexRay)
	SUP5-SRAUTOSEN	SUP5-SRAUTOSEN-FL	汽車感應器串列觸發和分析 (SENT)
	SUP5-SRCOMP	SUP5-SRCOMP-FL	電腦串列觸發和分析 (RS-232/422/485/UART)
	SUP5-SREMBD	SUP5-SREMBD-FL	嵌入式串列觸發和分析 (I ² C、SPI)
	SUP5-SRENET	SUP5-SRENET-FL	乙太網路串列觸發和分析 (10Base-T、100Base-TX)
	SUP5-SRUSB2	SUP5-SRUSB2-FL	USB 2.0 串列匯流排觸發和分析 (LS、FS、HS)
新增串列相容性	SUP5-CMAUTOEN	SUP5-CMAUTOEN-FL	汽車乙太網路相容性測試 (100BASE-T1)
新增進階分析	SUP5-DJA	SUP5-DJA-FL	進階抖動和眼圖分析
	SUP5-PWR	SUP5-PWR-FL	進階電源量測和分析
新增數位電壓計	SUP5-DVM	N/A	新增數位電壓計/觸發計頻器 (隨產品註冊免費附贈： www.tek.com/register5mso)

購買後的頻寬升級

日後新增頻寬升級

5 系列 MSO 產品在首次購買後可進行類比頻寬的升級。頻寬升級可根據 FlexChannel 輸入通道數目、當前頻寬和所需的頻寬來購買。達 1GHz 的頻寬升級，可藉由安裝軟體授權和新的前面板標籤於現場執行。若要升級至 2 GHz，則必須在 Tektronix 授權的服務中心進行安裝和校驗。從 350 MHz 或 500 MHz 到 1 GHz 或 2 GHz 的頻寬升級，也包含每個儀器通道一個 TPP1000 1 GHz 被動式探棒。

要升級的型號	升級前的頻寬	升級後的頻寬	訂購此頻寬升級
MSO54	350 MHz	500 MHz	SUP5-BW3T54
	350 MHz	1 GHz	SUP5-BW3T104
	350 MHz	2 GHz	SUP5-BW3T204 可選擇 IFC 或 IFCIN
	500 MHz	1 GHz	SUP5-BW5T104
	500 MHz	2 GHz	SUP5-BW5T204 可選擇 IFC 或 IFCIN
	1 GHz	2 GHz	SUP5-BW10T204 可選擇 IFC 或 IFCIN
MSO56	350 MHz	500 MHz	SUP5-BW3T56
	350 MHz	1 GHz	SUP5-BW3T106
	350 MHz	2 GHz	SUP5-BW3T206 可選擇 IFC 或 IFCIN
	500 MHz	1 GHz	SUP5-BW5T106
	500 MHz	2 GHz	SUP5-BW5T206 可選擇 IFC 或 IFCIN
	1 GHz	2 GHz	SUP5-BW10T206 可選擇 IFC 或 IFCIN
MSO58	350 MHz	500 MHz	SUP5-BW3T58
	350 MHz	1 GHz	SUP5-BW3T108
	350 MHz	2 GHz	SUP5-BW3T208 可選擇 IFC 或 IFCIN
	500 MHz	1 GHz	SUP5-BW5T108
	500 MHz	2 GHz	SUP5-BW5T208 可選擇 IFC 或 IFCIN
	1 GHz	2 GHz	SUP5-BW10T208 可選擇 IFC 或 IFCIN



Tektronix 通過 SRI 品質體系認證機構進行的 ISO 9001 和 ISO 14001 品質認證。



產品符合 IEEE 標準 488.1-1987、RS-232-C 與 Tektronix 標準代碼與格式。



評估的產品區：電子測試和量測儀器的規劃、設計/開發與製造。

產品規格表

東協 / 澳洲 (65) 6356 3900
比利時 00800 2255 4835*
中東歐及波羅的海各國 +41 52 675 3777
芬蘭 +41 52 675 3777
香港 400 820 5835
日本 81 (3) 6714 3086
中東、亞洲及北非 +41 52 675 3777
中華人民共和國 400 820 5835
韓國 +822-6917-5084, 822-6917-5080
西班牙 00800 2255 4835*
台灣 886 (2) 2656 6688

奧地利 00800 2255 4835*
巴西 +55 (11) 3759 7627
中歐及希臘 +41 52 675 3777
法國 00800 2255 4835*
印度 000 800 650 1835
盧森堡 +41 52 675 3777
荷蘭 00800 2255 4835*
波蘭 +41 52 675 3777
俄羅斯與獨立國協 +7 (495) 6647564
瑞典 00800 2255 4835*
英國及愛爾蘭 00800 2255 4835*

巴爾幹半島、以色列、南非及其他 ISE 國家 +41 52 675 3777
加拿大 1 800 833 9200
丹麥 +45 80 88 1401
德國 00800 2255 4835*
義大利 00800 2255 4835*
墨西哥、中南美洲及加勒比海 52 (55) 56 04 50 90
挪威 800 16098
葡萄牙 80 08 12370
南非 +41 52 675 3777
瑞士 00800 2255 4835*
美國 1 800 833 9200

* 歐洲免付費電話號碼。如果無法使用，請致電：+41 52 675 3777

詳細資訊 • Tektronix 會維護不斷擴充的應用摘要、技術摘要和其他資源等綜合資料，協助工程師使用最新技術。請造訪 tw.tek.com。

Copyright © Tektronix, Inc. 保留所有權利。所有 Tektronix 產品均受美國與其他國家已許可及審核中之專利權的保護。此出版資訊會取代之前發行的產品。保留規格和價格變更的權利。TEKTRONIX 及 TEK 為 Tektronix, Inc. 之註冊商標。其他所有參考的商標名稱各為其相關公司的服務標誌、商標或註冊商標。



17 Apr 2018 48T-60850-5

tw.tek.com/5SeriesMSO

Tektronix[®]

